



广东省计量强制检定管理平台 操作指引



扫码关注“广州能源检测研究院”微信公众号



广州能源检测研究院
GUANGZHOU INSTITUTE OF ENERGY TESTING

主要内容

1、省强检平台操作指引

《使用手册》在省平台首页下载，以省平台版本为准

2、各类别器具填写要求和模板

3、注意事项





根据广东省市场监督管理局相关要求，我院自**2023年1月1**日起，所有类别的强制检定计量器具（包括水表**DN≤32**、煤气表**≤G6**的民用表）均需在“广东省计量强制检定管理平台”完成系统线上备案，线上申请检定的办理流程，无需提供任何纸质备案资料，批量送检的计量器具需拆卸外包装。

广州市企事业单位未按要求完成平台注册、线上备案、预约检定及批量送检计量器具未拆卸外包装的，我院将不予受理。

省强检平台登录网址为：<https://www.gdqjp.com>

原“广州市强制检定计量器具备案管理系统”已于**2022年6月1**日停用，相关数据已迁移至省平台。



1、省强检平台操作指引

《使用手册》在省平台首页下载，以省平台版本为准



注册账户时，请留意以下信息，以确保审核通过：

< 返回主页

注册新用户

图片1:

1 选择注册类型
确定注册的账号属于哪种用户

2 填写资料
填写账号相关资料

3 完成
等待相应的技术机构审核

选择这个类型：请以企业身份注册，以个人身份注册，或以其它账号类型注册的不会被通过；注册时确保申请方名称和地址信息与证件信息一致。

申请方
强制检定工作计量器具的使用者注册此类用户

计量技术机构
负责提供检定服务的技术机构注册此类用户

计量行政部门
各地市负责行政管理的计量处、计量科注册此类用户

图片2:

* 详细地址 请按照营业执照/代码证中的地址填写

联系电话 请输入联系电话

邮编 请输入邮编

相关资料 选择文件 未选择任何文件 1 营业执照为必需项，必须上传清晰扫描件，以便核对单位信息。

上传营业执照或事业单位法人证书等文件，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式，总文件大小不可超过10M。

选择文件 未选择任何文件

注册人为法人时，请上传身份证正反面扫描件（务必放同一个文件）；如注册人非法人，请提供加盖公章的授权委托书（下载模板）

2 如注册人为法人时，请上传身份证正反面扫描件（务必放同一个文件）。

3 如注册人非法人，请提供加盖公章的授权委托书，需法人手签名确认，模板在此下载。

* 联系人 请输入联系人

电子邮箱 请输入电子邮箱

* 密码 8-20个字符，必须由数字、字母或符号两种以上组成

* 确认密码 请再输一次密码

* 手机 请输入手机号

* 验证码 请输入验证码 获取验证码



授权委托书

1 法人姓名

2 公司名称全称

3 被委托人姓名

本人(姓名)系(注册企业/单位名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人,代理人根据授权,以我方名义在“广东省计量强制检定管理平台”(网址:<https://www.gdqjp.com/>)上进行注册、操作和处理相关事宜,其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人手机号码为平台主账号,拥有系统操作管理的全部权限,与子用户有区别,建议为固定人员,不要频繁变动。如确有变动的,请及时变更委托人信息,以便管理账号。

注册单位/企业:(盖单位章)

4 加盖企业公章

法定代表人:(签字或盖章)

5 法人手签名或签名章

身份证号码:

6 法人身份证号,如法人为外籍人士,可填写护照号

委托代理人:(签字或盖章)

7 代理人手签名或签名章

身份证号码:

8 代理人身份证号

日期: 年 月 日

《授权委托书》填写要求如图



注册/登录/变更



用户注册

阅读注册说明，选择“申请方”，再选择企业/事业单位，提交申请后由辖区内的技术机构审核后可登录



用户登录

用户名+密码
手机号+手机验证码
微信扫码



忘记密码

用户名+手机号+手机验证码



找回用户名

申请方名称+社会统一信用
代码+联系人姓名
申请方名称+身份证号码+
联系人姓名



变更企业信息

原申请方名称+原社会统
一信用代码+原联系人姓
名



变更委托人

原申请方名称+原社会统一
信用代码+原联系人姓名



广州能源检测研究院
GUANGZHOU INSTITUTE OF ENERGY TESTING

常见情况

♥ 请使用谷歌内核的浏览器，如谷歌、火狐、**Safari**、**Edge**等浏览器；
若使用IE内核浏览器，操作界面易出现各种小问题，因此不建议使用IE、360、搜狗等浏览器登录省平台。

登录网址为：**<https://www.gdqjp.com>**





常见情况

- ①如企业账号原注册人或授权委托人变更（离职），没有交接账号信息的；或**主账号**姓名为原注册人或已离职同事，可通过【资料变更】的【变更委托人】方式修改；若账号姓名只是**子用户**，可通过**主账号**权限在【子用户】进行修改、删除、添加。
- ②企业变更单位名称或地址等信息，可在【资料变更】的【变更企业信息】发起申请；


The screenshot shows the '管理平台' (Management Platform) interface. It includes a login section with fields for '请输入用户名或手机号' (Please enter username or phone number) and '请输入密码' (Please enter password), a '7天之内免登录' (Login-free for 7 days) checkbox, and a '忘记密码' (Forgot password) link. Below the login section are links for '微信登陆' (WeChat login), '注册账户' (Register account), '找回用户名' (Recover username), '资料变更' (Account change), and '注册说明' (Registration instructions). A red box highlights the '找回用户名' link, with a callout indicating '仅找回用户名。' (Only recover username). Another red box highlights the '资料变更' link, with a callout indicating '原授权委托人已变更或离职，未交接无手机号码，可通过变更授权委托人的方式更新联系人和联系手机号码。' (Original authorized person has changed or resigned, no phone number handed over, can update contact and phone number by changing authorized person).

The screenshot shows the '资料变更申请' (Account Change Application) process flow. It includes a progress bar with four steps: 1. 变更类型 (Change type), 2. 验证用户 (Verify user), 3. 新信息 (New information), and 4. 完成 (Complete). Below the progress bar are two buttons: '变更企业信息' (Change enterprise information) and '变更委托人' (Change authorized person). A red box highlights the '变更委托人' button. Below the buttons is a user list table with a header '广州能源检测研究院-陈' (Guangzhou Institute of Energy Testing - Chen) and a dropdown arrow. A red box highlights the user list, with a callout indicating '若名字与实际不符' (If name does not match actual). The table shows a user with a status of '0' and '待审核用户' (User pending review).



省强检平台备案检定流程图

PS: 备案通过前可撤回修改所有信息, 备案通过后只能修改部分信息; 且已备案的器具不能删除, 请准确填写器具信息。
遵循1次备案, N次检定。

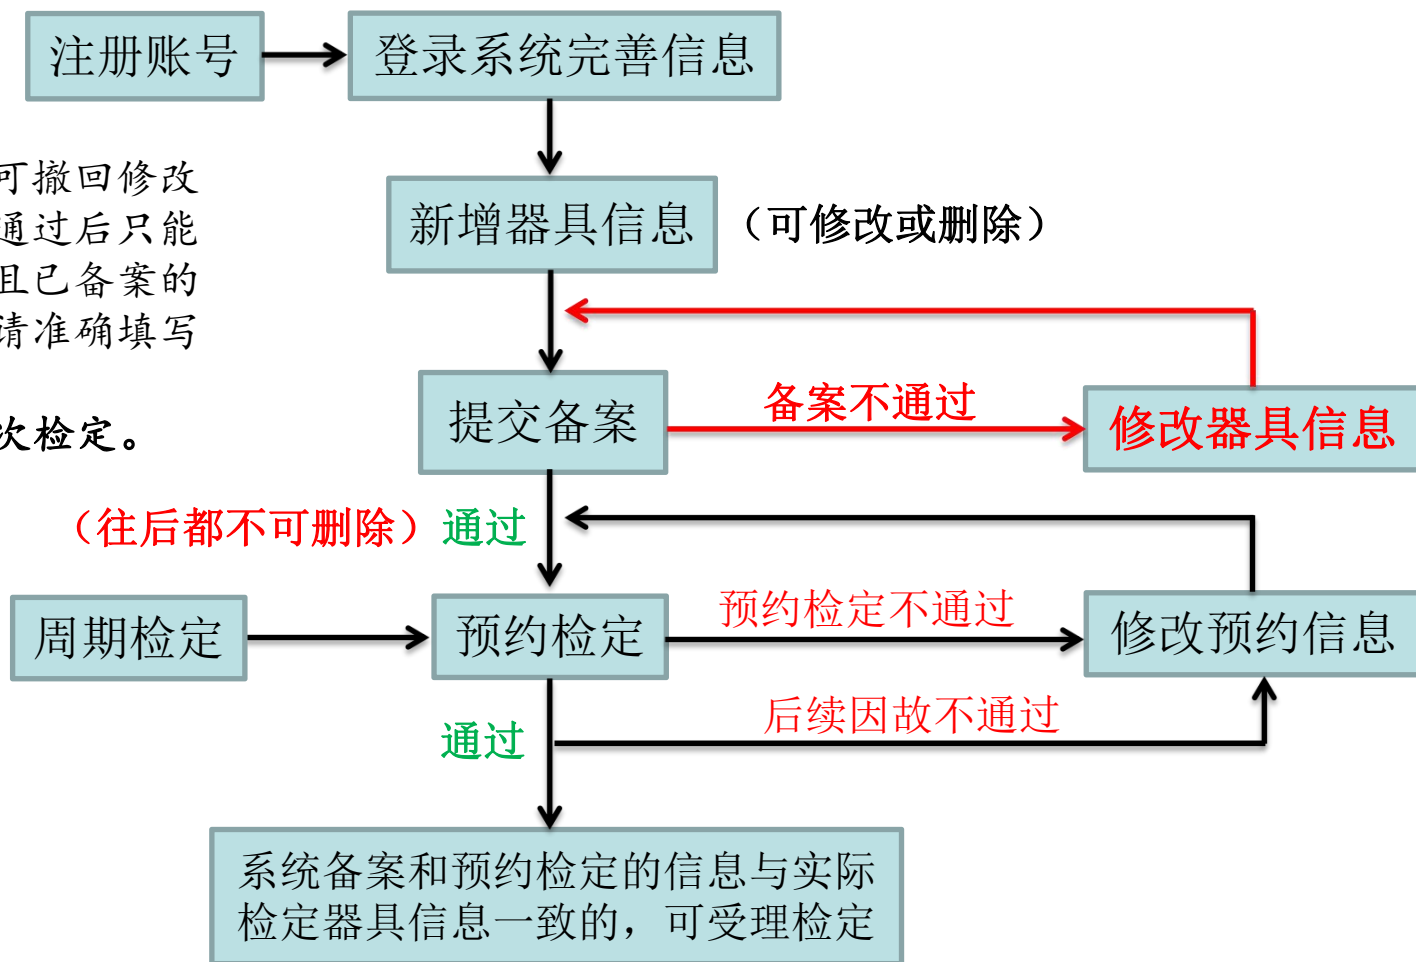



【仪器管理】状态说明

【全部仪器】显示用户的全部仪器，但不包括“已报废”状态的仪器。用户对仪器的大部分操作都在此界面进行。

【须检仪器】显示提交备案申请通过后 10 天内，或在有效期 30 天内的仪器。此界面提供“预约检定”的功能。

【超期未检】显示提交备案申请通过后超过 10 天，但不超过 30 天，或已超过有效期，但不超过 30 天的仪器。此界面提供“预约检定”及“停用”的功能。

【无效仪器】显示提交备案申请通过后超过 30 天或超过有效期 30 天的仪器。此界面提供“停用”的功能；无效满1个月后，平台将自动对其作【撤销备案】操作。

【不合格】显示检定不合格的仪器。此界面提供“预约检定”及“停用”的功能。

【已报废】显示状态为“已报废”的仪器，此界面只供查看功能。“**报废**”功能慎用，不能恢复使用，如某器具(器具名称+型号规格+出厂编号或自编号)已报废，则使用者不能添加同样(器具名称+型号规格+出厂编号或自编号)的器具。

【需重备案】仪器被检定机构撤销备案，可在此界面重新提交备案申请。


♥ **注意：重点留意上述时间限制，且慎重“报废”仪器。**



器具的时间标识



新加油机 没有检定史(有效期为空)
通过备案日期 2021.12.08

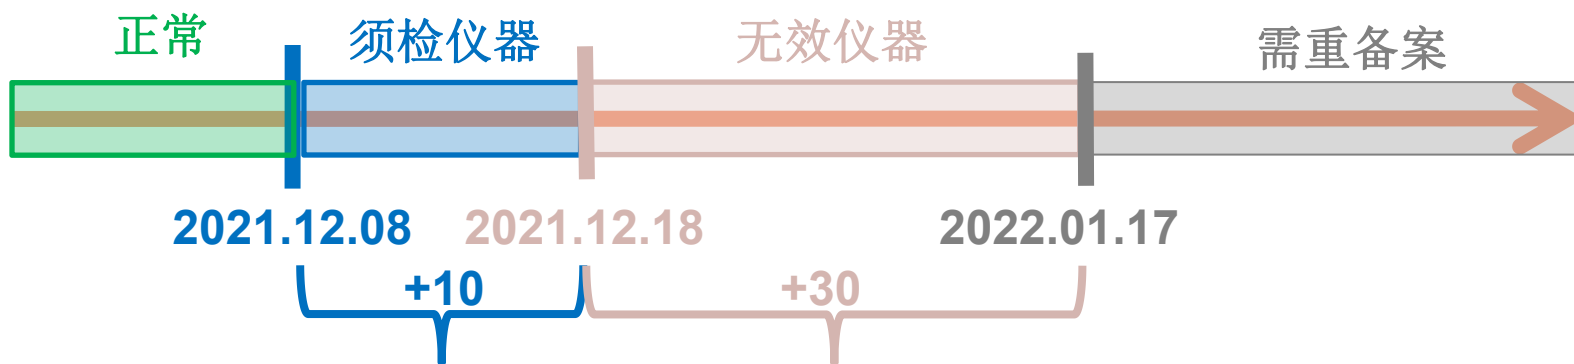




器具的时间标识



旧加油机 曾经检定过
检定日期 2021.12.08
有效期至 2022.06.07

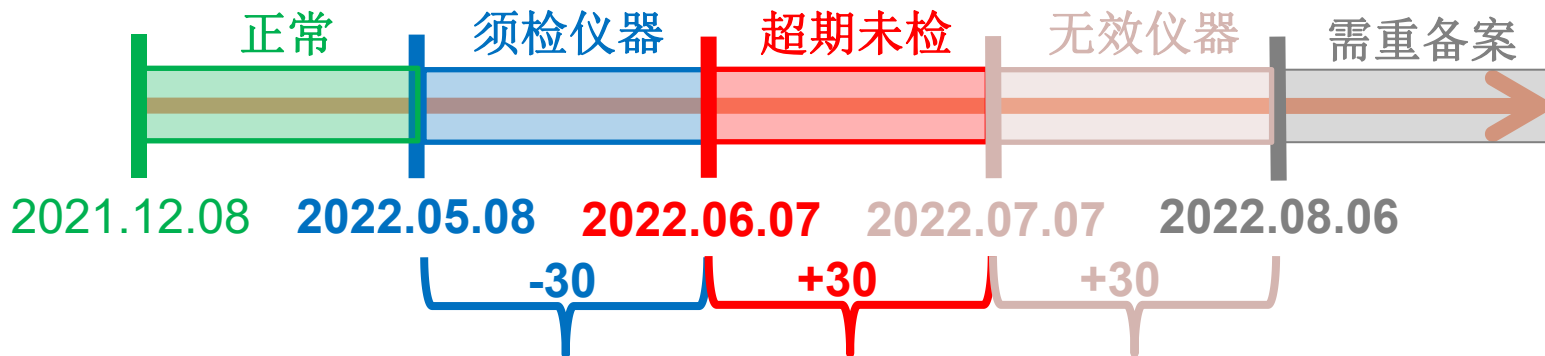



【备案管理】状态说明

【待备案】新增的仪器，仪器状态为“未备案”，可在此界面提交备案申请。

【已提交】已提交备案申请，但检定机构未处理的仪器，仪器状态为“已提交”，可在此界面进行“撤销备案”操作。

【被退回】提交的仪器备案申请被检定机构退回，仪器状态为“退回”，可在此界面重新提交备案申请。

【待处理】由市级机构转送至区县级机构，但县级机构无能力，退回给市级机构的仪器，仪器状态为“待处理”。

【待确认】由市级机构转送至区县级机构，或市级机构无能力，转送至省院的仪器，仪器状态为“待确认”。

【已审核】备案审核通过的仪器，仪器状态为“已备案”，**后续不可删除**。

【被撤销】备案审核通过，但在后续过程中因故被检定机构撤销备案状态的仪器，可在此界面进行“停用”或“报废”操作。

【已停用】“停用”状态的仪器，可在此界面进行“启用”或“报废”操作。



【检定管理】状态说明

【预约周检】通过筛选条件搜出需要预约周期检定的仪器，数量多时可先“加入待约检”，最后再在“待约检”一起提交周期检定申请。

【预约检定】备案审核通过后且有效期前1个月内，或新仪器备案通过后10天内的仪器，流程状态为“可预约”，可在此界面提交“预约检定”申请。

【预约中】提交预约检定申请后，检定机构还未处理的订单，流程状态为“已提交预约”，订单状态为“待确认”，可在此界面“撤销”预约或“合并预约单”。

【已确认】检定机构审核通过预约检定申请，流程状态为“已受理待送检”，订单状态为“待检”。

【被拒绝】仪器被检定机构作接收登记后，再被拒绝退回，流程状态为“被退回”，订单状态为“已拒绝”，在此界面可确认机构拒绝原因。

【被退回】检定机构审核预约检定时不通过退回的器具，流程状态为“未检退回”，可在此界面重新提交预约检定申请。

【历史查询】通过筛选条件检索历史预约情况。



其他状态说明

【在检】流程状态为“在检”，检定机构受理预约检定并对仪器作接收登记后。

【已完检】检定机构完成检定，并对仪器进行完检登记后，一般为检定合格的仪器。

【不合格】经检定机构检定为不合格，并对器具进行完检登记后，可查看不合格原因。

【证书查询】显示机构出具的证书，可根据检定日期、证书号、证书类型检索查询。

【子用户】可设置多个子账号，子账号用手机号登录，并拥有跟主账号一样的权限。

只有主账号才有添加、修改、删除子用户的权限，子用户没有该权限。

查询：通过输入手机号，快速定位子用户。

添加子用户：输入姓名、手机号和手机验证码后，点击【保存】按钮。

该手机号不能跟其他已注册用户的手机号重复。

编辑：编辑子用户姓名和手机号，需要通过手机验证码验证。

删除：删除子用户。

设置密码：设置子用户的登陆密码，添加子用户成功后，需先设置初始密码。

设置权限：设置子用户的权限。



预约周期检定

- 1、一般操作方法：**①在【仪器管理】里先报废或停用无关器具→②到【检定管理】的【预约周检】通过条件筛选（如有效期、送检或现场、器具种别或类别等）需约检的器具提交申请→③若有新增器具，先完成备案，再发起预约检定→④因新旧器具发起多个预约订单的，可在【预约中】选中同类项点击【合并预约单】合并为一个预约单。
- 2、采用购物车式预约：**数量多且跨页时，在【预约周检】按条件检索器具，把需要预约的器具【加入待约检】，再在【待约检】一起提交申请。
- 3、如器具已超期：**可在【仪器管理】的【超期未检】列表中，对需要停用的器具进行停用操作，然后再发起【预约检定】，或结合上述方式操作。



预约周期检定

4、采用Excle表批量预约：在【须检仪器】、【超期未检】、【预约周检】、【预约检定】搜索出需预约检定的器具信息，点击【导出】，在导出的Excle表中整理数据，把本次不需预约或需停用和报废的器具删除，留下需要预约检定的器具信息，再点击【待预约】，点击【导入选中列表】导入整理后的Excle表数据，成功导入数据的页面将显示Excle表对应的信息（已剔除无需检定的器具信息），最后点击【提交预约】，即可实现批量预约检定申请。（见下图1、图2）

若存在“送检”和“现场”两种方式的，需分开导入，分别提交；若需批量修改为单一送检方式的，可点击【更多】，统一按“送检”或“现场”预约。（见下图3）

♥ **注意：**导出的Excle表不要修改表格原有的格式，只能对数据信息做删减和修改，否则将无法成功导入。



采用Excel表批量预约操作步骤:

图 1:

图 1 展示了广州能源检测研究院的预约系统界面，重点标注了采用 Excel 表批量预约的操作步骤。

界面布局：

- 左侧导航栏：**包含首页、仪器管理、计量标准、备案管理、检定管理、预约周检、预约检定、预约中、已确认、被拒绝、被退回、历史查询、证书查询、子用户等选项。其中“预约周检”和“预约检定”被红色框选中，并标注了“1 先找到对应的页面，两个窗口均可操作。”
- 顶部操作区：**包含多个筛选条件（请选择检定机构、有效期从、至、请选择检验方式、请输入仪器名称、请输入出厂编号、请输入自编号、请输入安装使用地点）和查询按钮（查询、按条件搜索出相关器具信息）。此外，还有导出按钮（导出）、加入待约检按钮（加入待约检）、待约检按钮（待约检）、提交选中按钮（提交选中）、提交全部按钮（提交全部）和更多按钮（更多）。其中“导出”按钮被红色框选中，并标注了“3 导出相应数据的Excel表”。
- 数据表格：**显示了器具信息列表，包括序号、操作、器具名称、出厂编号、型号规格、自编号、测量范围、准确度等级、使用区域、安装使用地点等列。表格中有多条记录，其中第 8 条记录（燃油加油机）被蓝色高亮显示。表格下方有“选择列”和“总数：33行”的提示。
- 底部操作区：**包含分页控件，显示当前页为 1，共 15 条/页，以及“跳至”按钮。

操作步骤标注：

- 1 先找到对应的页面，两个窗口均可操作。（指向左侧导航栏的“预约周检”和“预约检定”按钮）
- 2 按条件搜索出相关器具信息。（指向顶部的“查询”按钮）
- 3 导出相应数据的Excel表。（指向顶部的“导出”按钮）
- 4 先整理Excel表数据，然后点击待约检。（指向顶部的“待约检”按钮）



采用Excle表批量预约操作步骤:

图 2:

图 2 展示了广州能源检测研究院的预约系统界面，用于批量导入 Excel 表数据进行预约操作。界面主要分为左侧导航栏、顶部面包屑、主操作区、数据列表和底部状态栏。

左侧导航栏: 包含首页、仪器管理、计量标准、备案管理、检定管理、预约质检、预约检定、预约中、已确认、被拒绝、被退回、历史查询、证书查询、子用户等选项。

顶部面包屑: 显示当前路径为 首页 > 检定管理 > 可预约仪器列表 > 待处理列表。

主操作区: 包含返回按钮、导入选中列表按钮（红色框标注）、移除选中按钮、清空按钮、提交预约按钮（红色框标注）和更多按钮。上方提示 1: 点击【导入选中列表】，导入整理后的Excel表数据。

数据列表: 包含以下列: #, 操作, 器具名称, 出厂编号, 型号规格, 自编号, 检定方式, 检定机构, 有效期至。列表显示了 14 条数据，包括水银血压计、燃气表、电子血压计和立式金属罐等。

底部状态栏: 包含选择列按钮、总数: 31行、导入后可核对一下数据行数，数量与整理后的Excel表数量一致（红色框标注）、分页信息（15条/页）和页码（1, 2, 3, 1, 页）。

右侧提示: 提示 3: 确认导入数据无误后，点击【提交预约】，即可发起预约检定申请。



采用Excel表批量预约操作步骤:

图 3:

首页 > 检定管理 > 可预约仪器列表 > 待处理列表

返回

1 导入整理后的Excel表

导入选中列表 x 移除选中 清空 提交预约 更多

按送检预约 按现场预约

3 若需统一修改为单一检定方式, 则点击右上角“更多”, 可批量修改检定方式并提交预约检定申请。

2 若存在“送检”和“现场”两种方式, 需分开导入, 分开提交预约。

☐	#	操作	器具名称	出厂编号	型号规格	自编号	检定方式	检定机构	有效期至
☐	1	查看	水银血压计(测试)	22356063	(0~40)kPa		送检	广州能源检测研究院	2022-12-14
☐	2	查看	水银血压计(测试)	22356064	(0~40)kPa		送检	广州能源检测研究院	2022-12-14
☐	3	查看	水银血压计(测试)	22356065	(0~40)kPa		送检	广州能源检测研究院	2022-12-14
☐	4	查看	燃气表(测试)	2009085610	QK2000-G16		送检	广州能源检测研究院	2028-05-10
☐	5	查看	燃气表(测试)	A084	QK2000-G16		送检	广州能源检测研究院	2025-05-31
☐	6	查看	燃气表(测试)	A085	QK2000-G16		送检	广州能源检测研究院	2025-05-31
☐	7	查看	燃气表(测试)	A089	QK2000-G16		送检	广州能源检测研究院	2032-06-05
☐	8	查看	电子血压计(测试)	A002	HEM-8102A		送检	广州能源检测研究院	2023-06-05
☐	9	查看	电子血压计(测试)	A018	HEM-8102B		送检	广州能源检测研究院	2023-06-14
☐	10	查看	电子血压计(测试)	A019	HEM-8102B		送检	广州能源检测研究院	2023-06-14
☐	11	查看	电子血压计(测试)	A020	HEM-8102B		送检	广州能源检测研究院	2023-06-14
☐	12	查看	立式金属罐(测试)	A106	5000m³		现场	广州能源检测研究院	2024-05-31
☐	13	查看	立式金属罐(测试)	A107	1000m³		现场	广州能源检测研究院	2024-05-31
☐	14	查看	立式金属罐(测试)	A108	2000m³		现场	广州能源检测研究院	2024-06-07

选择列 总数: 31行

1 2 3 > 15条/页 跳至 1 页



2、各类别器具填写要求和模板

(能源院承检的计量器具)



一级序号	二级序号	一级目录	二级目录	监管方式	范围及说明
5	6	计量罐	船舶液货计量舱（供油船舶计量舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱 5000载重吨以下）	V	用于贸易结算
	7		立式金属罐	V	用于贸易结算
8	10	加油机	燃油加油机	P+V	用于贸易结算
9	11	加气机	液化石油气加气机	P+V	用于贸易结算
	12				
	13		液化天然气加气机	P+V	用于贸易结算
10	14	水表	水表DN15~DN50	P+V	用于贸易结算
11	15	燃气表	燃气表G1.6~G16	P+V	用于贸易结算
13	17	流量计	流量计（口径范围DN300及以下）	P+V	用于贸易结算
14	18	血压计（表）	无创自动测量血压计	P+V	用于医疗卫生
	19		无创非自动测量血压计	P+V	用于医疗卫生



各类别器具填写要求和模板

一、在系统新增器具信息，可逐条新增，也可下载模板批量导入：

① 所填器具基础信息必须准确无误，**严格按照仪器的铭牌信息录入**；添加仪器后，相似的仪器可通过“复制”来进行快速录入。

♥ **注意：仪器名称、型号规格、出厂编号、自编号，四者相同将视为同一台仪器，重复添加时系统将不允许保存，请准确填写器具信息。**

② 下载模板批量导入时，严格按照填写要求填入信息，尤其是各类别的代码数字，**对应的字段只能填写相应的数字，不能填写文字！**请认真填写核对代码，避免错误。

③ 仪器最终备案所在的机构为仪器的检定机构，因此需按照各检定机构的承检范围提交备案和检定申请，否则将无法审核通过。



各类别器具填写要求和模板

二、大批量送检水表、燃气表时，建议采用下载模板批量导入：

由于不同类型和规格的水表、燃气表相关要求不同，为便于区分受理，请严格按照仪器的准确信息进行备案，并按仪器的实际名称、规格型号或管径大小等填写批量导入模板，不同的类型和规格或管径需分别导入，分别提交订单。

①不同类型需分开提交，如：机械水表与远传水表、电磁水表等智能水表的区别；

膜式燃气表与IC卡无线远传膜式燃气表等智能燃气表的区别。

②不同规格或管径需分开提交，如：水表DN15/DN20/DN25/DN32/DN40/DN50的区别；

燃气表G1.6/G2.5/G4/G6/G10/G16的区别。

③结合以上①和②的情况，注意分别提交备案和检定订单。



流量计填写模板，各单位照实填写相关内容：

仪器信息

* 器具名称	按铭牌信息准确填写（例如：数字式涡街流量计、智能涡街流量计、气体涡街流量计等）			* 型号规格	按铭牌信息准确填写			
测量范围	按铭牌信息准确填写			准确度等级	按铭牌信息准确填写			
* 出厂编号	按铭牌信息准确填写			自编号	根据单位内部管理需要填写			
* 生产厂家	按铭牌信息准确填写			* 安装使用地点	例如：广州市XX区XX路XX号		购买日期	请选择购买日期
器具状态	新增	器具用途	贸易结算	器具类型	工作计量器具	* 检定方式	送检	
* 所属地	广东省 / 广州市 / 番禺区			* 种别	流量计	* 类别	流量计（口径范围DN300及以下）	
检定机构				器具编码			型评证书号	
备案状态		流程状态		检定证书号			有效期至	请选择有效期至
自定义标签	请输入自定义标签，多个标签用空格隔开			备注	请输入备注			
相关资料	选择文件 未选择任何文件							
上传相关资料，仅支持扩展名为.jpg,.jpeg,.png,.pdf,.zip,.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。								
相关资料	选择文件 未选择任何文件							
上传型式评报告，仅支持扩展名为.jpg,.jpeg,.png,.pdf,.zip,.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。								

✓ 保存

✕ 取消



水表填写模板，各单位照实填写相关内容：

仪器信息

* 器具名称	按铭牌信息准确填写（例如：水表、无线远传冷水水表、超声水表等）			* 型号规格	按铭牌信息准确填写				
测量范围	按铭牌信息准确填写（如不确定，则按水管管径大小填写，例如：DN40、DN50）			准确度等级	按铭牌信息准确填写				
* 出厂编号	按铭牌信息准确填写			自编号	根据单位内部管理需要填写				
* 生产厂家	按铭牌信息准确填写		生产地	国产	* 安装使用地点	例如：广州市XX区XX路XX号	购买日期	请选择购买日期	
1 生产地 根据前面 生产厂家 信息选择“国产”或“进口”				2 安装使用地点必须填写详细地址，如首次检定不确定，可填写为广州市XX区					
器具状态	新增	器具用途	贸易结算	器具类型	工作计量器具	* 检定方式	送检		
* 所属地	广东省 / 广州市 / 番禺区			3 此处按仪表实际安装所属区域选择	* 种别	水表	* 类别	水表DN15~DN50	
检定机构				器具编码			型评证书号		
备案状态			流程状态			检定证书号	有效期至	请选择有效期	
自定义标签	请输入自定义标签，多个标签用空格隔开							备注	请输入备注
相关资料									
选择文件 未选择任何文件									
请上传相关资料，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。									
选择文件 未选择任何文件									
请上传型式评报告，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。									
✓ 保存 × 取消									



燃气表填写模板，各单位照实填写相关内容：

仪器信息

* 器具名称	按铭牌信息准确填写（例如：膜式燃气表、IC卡膜式燃气表、无线远传膜式燃气表等）			* 型号规格	按铭牌信息准确填写			
测量范围	按铭牌信息准确填写（如不确定，则按燃气表规格填写，例如：G10、G16）			准确度等级	按铭牌信息准确填写			
* 出厂编号	按铭牌信息准确填写			自编号	根据单位内部管理需要填写			
* 生产厂家	按铭牌信息准确填写		生产地	国产	* 安装使用地点	例如：广州市XX区XX路XX号	购买日期	请选择购买日期
1 生产地 根据前面的生产厂家选择“国产”或“进口”				2 安装使用地点必须填写详细地址信息，如首次检定不确定，至少填写为广州市XX区				
器具状态	新增	器具用途	贸易结算	器具类型	工作计量器具	* 检定方式	送检	
* 所属地	广东省 / 广州市 / 番禺区 3 此处按照仪表实际安装使用区域填写			* 种别	燃气表	* 类别	燃气表G1.6~G16	
检定机构				器具编码				
备案状态		流程状态		检定证书号	有效期至 请选择有效期			
自定义标签	请输入自定义标签，多个标签用空格隔开			备注	请输入备注			
相关资料	选择文件 未选择任何文件 上传相关资料，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。							
	选择文件 未选择任何文件 请上传型式评报告，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。							
✓ 保存				✕ 取消				



电子血压计填写模板，各单位照实填写相关内容：

仪器信息

* 器具名称	按铭牌信息准确填写（例如：电子血压计）			* 型号规格	按铭牌信息准确填写【例如：（0~39.9）kPa HEM-7136】					
测量范围	按铭牌信息准确填写【例如：（0~39.9）kPa】			准确度等级	±0.5kPa 5 供参考填写					
* 出厂编号	按铭牌信息准确填写			自编号	根据单位内部管理需要填写					
* 生产厂家	按铭牌信息准确填写		生产地	国产		* 安装使用地点	例如：广州市XX区XX路XX号	购买日期	请选择购买日期	
			1 生产地 根据前面的 生产厂家 选择“国产”或“进口”					2 安装使用地点必须填写详细地址，如有必要，可详细填写至具体使用部门或科室		
器具状态	新增		器具用途	医疗卫生		器具类型	工作计量器具		* 检定方式	送检
* 所属地	广东省 / 广州市 / 番禺区		3 此处按仪器使用区域选择							
检定机构										
备案状态			流程状态							
自定义标签	请输入自定义标签，多个标签用空格隔开									
相关资料	选择文件 未选择任何文件									
请上传相关资料，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式，总文件大小不可超过10M。										
	选择文件 未选择任何文件									
请上传型式评报告，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式，总文件大小不可超过10M。										
备注 请输入备注										

♥ 检定方式：根据每批次需检定的血压计数量，选择“送检”或“现场”。

✓ 保存

✕ 取消



水银血压计填写模板，各单位照实填写相关内容：

仪器信息

* 器具名称

按铭牌信息准确填写（例如：水银血压计、血压计）

测量范围

按铭牌信息准确填写【例如：（0~40）kPa】

1 供参考填写

* 出厂编号

按铭牌信息准确填写

* 生产厂家

按铭牌信息准确填写

生产地

国产

3 生产地 根据前面的 生产厂家 选择“国产”或“进口”

器具状态

新增

器具用途

医疗卫生

* 所属地

广东省 / 广州市 / 番禺区

5 此处按仪器实际使用区域选择

检定机构

备案状态

流程状态

自定义标签

请输入自定义标签，多个标签用空格隔开

相关资料

选择文件 未选择任何文件

请上传相关资料，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。

选择文件 未选择任何文件

请上传型式评报告，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。

* 型号规格

按铭牌信息准确填写【例如：（0~40）kPa】

准确度等级

±0.5kPa

2 供参考填写

自编号

根据单位内部管理需要填写

* 安装使用地点

例如：广州市XX区XX路XX号

购买日期

请选择购买日期

4 安装使用地点必须填写详细地址信息，如有必要，可详细填写至具体使用部门或科室

器具类型

工作计量器具

* 检定方式

送检

6 血压计或水银血压计属于无创非自动测量血压计

* 种别

血压计（表）

* 类别

无创非自动测量血压计

器具编码

型评证书号

检定证书号

有效期至

请选择有效期

备注

请输入备注

✓ 保存

✕ 取消

♥ 检定方式：根据每批次需检定的血压计数量，选择“送检”或“现场”。



燃油加油机填写模板，各单位照实填写相关内容：

 仪器信息

* 器具名称	按铭牌信息准确填写（例如：燃油加油机）		* 型号规格	按铭牌信息准确填写（例如：THW2066B3）	
测量范围	按铭牌信息准确填写【例如：（4.5~45）L/min】		准确度等级	按铭牌信息准确填写（例如：±0.30%）	
* 出厂编号	按照加油机铭牌上的出厂编号填写		自编号	按照加油站自编号填写，如1-92、2-95	
* 生产厂家	按铭牌信息准确填写	生产地	国产	* 安装使用地点	例如：广州市XX区XX路XX号
		1 生产地 根据前面的 生产厂家 选择“国产”或“进口”		2 安装使用地点必须填写详细地址信息	
器具状态	新增	器具用途	贸易结算	器具类型	工作计量器具
* 所属地	广东省 / 广州市 / 番禺区	3 此处根据仪器实际安装使用区域选择		* 种别	加油机
				* 类别	燃油加油机
检定机构			器具编码	型评证书号	
备案状态		流程状态		检定证书号	有效期至
					请选择有效期
自定义标签	请输入自定义标签，多个标签用空格隔开		备注	请输入备注	



立式金属罐填写模板，各单位照实填写相关内容：

仪器信息

* 器具名称	按铭牌信息准确填写（例如：立式金属罐）			* 型号规格	按铭牌信息准确填写（例如：5000m³）		
测量范围	按铭牌信息准确填写【例如：（0~5000）m³】			准确度等级	按铭牌信息准确填写（例如：0.1%）		
* 出厂编号	根据实际使用情况填写			自编号	根据单位内部管理需要填写		
* 生产厂家	按铭牌信息准确填写	生产地	国产	* 安装使用地点	例如：广州市XX区XX路XX号	购买日期	请选择购买日期
		1 生产地 根据前面的 生产厂家 选择“国产”或“进口”		2 安装使用地点必须填写详细地址信息			
器具状态	新增	器具用途	贸易结算	器具类型	工作计量器具	* 检定方式	现场
* 所属地	广东省 / 广州市 / 番禺区 3 此处根据实际安装使用区域选择			* 种别	计量罐	* 类别	立式金属罐
检定机构				器具编码			
备案状态		流程状态		检定证书号			
自定义标签	请输入自定义标签，多个标签用空格隔开			备注	请输入备注		

相关资料 未选择任何文件

请上传相关资料，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式，总文件大小不可超过10M。

未选择任何文件

请上传型式评报告，仅支持扩展名为.jpg、.jpeg、.png、.pdf、.zip、.rar等的文件格式，总文件大小不可超过10M。

✓ 保存

✕ 取消



液化石油气加气机（LPG）填写模板，各单位照实填写相关内容：

仪器信息

* 器具名称	按铭牌信息准确填写（例如：LPG加气机）			* 型号规格	按铭牌信息准确填写（例如：JQ060L-E-6G）					
测量范围	按铭牌信息准确填写（例如：10~60L/min）			准确度等级	按铭牌信息准确填写（例如：±1.0%）					
* 出厂编号	按照加气机铭牌上的出厂编号填写			自编号	按照加气站自编号填写，如1-92、2-95					
* 生产厂家	按铭牌信息准确填写		生产地	国产	* 安装使用地点	例如：广州市XX区XX路XX号	购买日期	请选择购买日期		
			1 生产地 根据前面的 生产厂家 选择“国产”或“进口”		2 安装使用地点必须填写详细地址信息					
器具状态	新增	器具用途	贸易结算	器具类型	工作计量器具	* 检定方式	现场			
* 所属地	广东省 / 广州市 / 番禺区 3 此处根据仪器实际安装使用区域选择			* 种别	加气机	* 类别	液化石油气加气机			
检定机构				器具编码				型评证书号		
备案状态			流程状态			检定证书号			有效期至	请选择有效期
自定义标签	请输入自定义标签，多个标签用空格隔开			备注	请输入备注					
相关资料	选择文件 未选择任何文件 请上传相关资料，仅支持扩展名为.jpg,.jpeg,.png,.pdf,.zip,.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。 选择文件 未选择任何文件 请上传型评报告，仅支持扩展名为.jpg,.jpeg,.png,.pdf,.zip,.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。									
✓ 保存 ✕ 取消										



液化天然气加气机（LNG）填写模板，各单位照实填写相关内容：

仪器信息

* 器具名称	按铭牌信息准确填写（例如：LNG加气机）			* 型号规格	按铭牌信息准确填写（例如：HQHP-JYJ-80-IV-A）		
测量范围	按铭牌信息准确填写（例如：80kg/min）			准确度等级	按铭牌信息准确填写（例如：±1.5%）		
* 出厂编号	按照加气机铭牌上的出厂编号填写			自编号	按照加气站自编号填写，如1-92、2-95		
* 生产厂家	按铭牌信息准确填写	生产地	国产	* 安装使用地点	例如：广州市XX区XX路XX号	购买日期	请选择购买日期
		1 生产地 根据前面的 生产厂家 选择“国产”或“进口”		2 安装使用地点必须填写详细地址信息			
器具状态	新增	器具用途	贸易结算	器具类型	工作计量器具	* 检定方式	现场
* 所属地	广东省 / 广州市 / 番禺区 3 此处根据仪器实际安装使用区域选择			* 种别	加气机	* 类别	液化天然气加气机
检定机构				器具编码			
检定证书号				有效期至	请选择有效期		
自定义标签	请输入自定义标签，多个标签用空格隔开			备注	请输入备注		
相关资料	选择文件 未选择任何文件 请上传相关资料，仅支持扩展名为.jpg,.jpeg,.png,.pdf,.zip,.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。 选择文件 未选择任何文件 请上传型式报告，仅支持扩展名为.jpg,.jpeg,.png,.pdf,.zip,.rar等的文件格式,总文件大小不可超过10M。						

✓ 保存

✕ 取消



下载模板批量导入填写模板，需严格按照填写要求填入信息：

(以下代码数字仅为例子，请根据新增器具实际情况填入相应代码)

器具名称	型号规格	测量范围	准确度等级	出厂编号	自编号	生产厂家	生产地	购买日期	安装使用地点	器具状态	器具用途	器具类型	检定方式	所在地代码	种别代码	POS机显示硬件版本(加油机用)
电子血压计	(0~39.9) kPaHEM-8102B	(0~39.9) kPa	±0.5kPa	LF20110100053		欧姆龙(大连)有限公司	2		广州市xx区xx路xx号xx	1	2	3	1	440103	065001	
水银血压计	(0~40) kPa	(0~40) kPa	±0.5kPa	22356056		江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	1		广州市xx区xx路xx号xx	1	2	3	1	440104	065002	
燃油加油机	THW2066B3	(4.5~45) L/min	±0.30%	1702885P	1-92	托肯恒山科技(广州)有限公司	1		广州市xx区xx路xx号xx	1	4	3	2	440105	015001	根据省局要求，只有V2015和V2018才允许备案，低于这两个版本的，要更新新版防作弊系统后才能进行备案。
LPG加气机	JQ060L-E-6G	10-60L/min	±1.0%	JQ0606	1-95	合肥精大仪表有限公司	1		广州市xx区xx路xx号xx	1	4	3	2	440106	59002	
LNG加气机	HQHP-JYJ-80-	80kg/min	±1.5%	12345A	1-98	合肥精大仪表有限公司	1		广州市xx区xx路xx号xx	1	4	3	2	440106	59002	
水表	MTW-4(DN40)	DN40	2级	1234567909		迈拓仪表股份有限公司	1		广州市xx区xx路xx号xx	1	4	3	1	440111	023003	
燃气表	QK2000-G16	0.16-25m³/h	1.5级	2009085609		重庆前卫表业有限公司	1		广州市xx区xx路xx号xx	1	4	3	1	440112	072001	
涡街流量计	7F2C80-AQ3/0	0~4t/h	0.5级	P8126518000		恩德斯豪斯流量仪表技术(中国)有限公司	1		广州市xx区xx路xx号xx	1	4	3	1	440113	063001	
立式金属罐	4000m³	(0~5000) m³	0.1%	G1		中油六建	1		广州市xx区xx路xx号xx	1	4	3	2	440114	014001	

标黄色部分，均需严格按照导入模板的填写要求，填入与备案检定器具实际情况相符的代码数字，才能成功导入报表，另绿色部分为“加油机专用”要求。



下载模板批量导入填写说明，需严格按照填写要求填入信息：

- 1、字段‘生产地’只能为数字：1.国产，2.进口
- 2、字段‘器具状态’只能为数字：1.新增，2.启用
- 3、字段‘器具用途’只能为数字：1.安全防护；2.医疗卫生；3.环境监测；4.贸易结算
- 4、字段‘器具类型’只能为数字：1.社会公用计量标准，2.部门和企事业单位最高计量标准，3.工作计量器具
- 5、字段‘检定方式’只能为数字：1.送检，2.现场
- 6、字段‘所属地代码’：请依据基础数据《行政区域代码（所属地代码）》，系统下载模板时有附录。
- 7、字段‘种别代码’：请依据基础数据《2019新版强检目录信息(含种别代码)》，系统下载模板时有附录。
- 8、日期字段格式为"yyyy-MM-dd"

注：标红字段为必填项。

♥ 便捷方法：先手动新增一个器具信息，导出表格，在导出的表格里完善全部信息后批量导入（适用于基本信息大致相同的批量器具，不然各代码有差异）。



广州能源检测研究院
GUANGZHOU INSTITUTE OF ENERGY TESTING

3、注意事项



♥ 注意事项

1、按院所资质、按仪器类别、介质分开提交备案和检定申请：由于不同的院所承检的仪器不同，且不同类别的仪器、不同介质的流量计归属不同的专业部门进行检定，**仪器最终备案所在的机构为仪器的检定机构**，提交备案申请时，一定要按照各院所的承检范围，以及按类别、介质分开提交，否则将无法审核通过。

例如：

- （送检）介质为“气”的，如 涡街流量计、涡轮流量计、罗茨流量计等归为一类。
- （送检）介质为“水”的，如 电磁流量计、质量流量计、超声波流量计等归为一类。
- （送检）水表 $DN \leq 50$ ，**大批量送检时，不同管径、不同名称的水表请分开提交订单。**
- （送检）煤气表 $G \leq 16$ ，**大批量送检时，不同规格、不同名称的燃气表请分开提交订单。**
- （现场）立式金属罐归为一类。
- （现场）加油机归为一类。
- （现场）加气机归为一类。
- （送检**或**现场）血压计归为一类。



♥ 注意事项

2、送到检定机构实验室进行检定的检定方式为“送检”，需检定机构安排工程师到客户现场检定的检定方式为“现场”：

送检受理点	联系电话	详细地址	受检器具
番禺	020-62874649 020-62874650	广州市番禺区石楼镇珠江路1-2号综合楼 北侧收发大厅	水表、燃气表、 流量计等

现场检定，各小组联系方式：		
1	加油机	020-62874787
2	加气机	13929531773
3	血压计：单次送检≤30台	请送实验室检定
4	血压计：单次送检>30台	15602218953
5	立式金属罐	020-62874778
温馨提示：提交预约检定后，需主动联系检定小组预约现场检定时间，以双方确认的时间为准。		



♥ 注意事项

3、如有系统操作问题，详细查看《广东省强检平台-使用手册-申请方》；
如有业务流程问题，可联系相应的检定机构。

以下是各检定机构联系方式：

法定计量检定机构	联系方式
广州计量检测技术研究院	020-83365352、020-32086301
广州能源检测研究院	020-81099177、020-62874633
番禺质量技术监督检测所	020-84613052
花都质量技术监督检测所	020-86979093
从化质量技术监督检测所	020-62160178、020-62160210
增城质量技术监督检测所	020-82740850、020-82747002



❤️ 注意事项

4、系统页面默认显示15条计量器具信息，当全选数量大于当前页显示的15条数据时，可在右下角位置选择页面显示数量的变更，单页显示最多数量为500条/页，如下图：

首页 > 仪器管理 > 全部仪器

请输入仪器名称 请输入型号规格 请输入出厂编号 请输入唯一编码 请选择备案状态 请选择流程状态 查询 更多条件

+ 添加 × 删除 清空 停用 报废 导入 更多导入 模板 导出

☐	#	操作	器具名称	出厂编号	型号规格	自编号	测量范围	准确度等级	使用区域	安
☐	1	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/10号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	2	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/1号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	3	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/2号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	4	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/3号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	5	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/4号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	6	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/5号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	7	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/6号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	8	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/7号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	9	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/8号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	10	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A/9号枪	JQO60L-E-6G		10-60L/min	±1.0%	广东省广州市天河区	
☐	11	查看 编辑 复制	水银血压计(测试)	22356056	(0~40)kPa		(0~40) kPa	±0.5kPa	广州市越秀区	
☐	12	查看 编辑 复制	水银血压计(测试)	22356057	(0~40)kPa		(0~40) kPa	±0.5kPa	广州市越秀区	

选择列 总数: 134行

系统页面默认显示15条计量器具信息，如有需要多选或者全选，可在此处选择页面显示数量的变更。

15 条/页 30 条/页 50 条/页 100 条/页 300 条/页 500 条/页

15 条/页 跳至 1 页



♥注意事项

5、当需要【**预约检定**】的仪器数量多，且跨页时，可先将仪器【加入待约检】中，然后再进入【待约检】一起提交。

The screenshot displays a web interface for instrument management. At the top, there are three input fields for '请输入出厂编号' (Please enter factory number), '请输入自编号' (Please enter self-number), and '请输入' (Please enter). Below these fields is a row of five buttons: '导出' (Export) in blue, '加入待约检' (Add to Pending Inspection) in white with a plus icon, '待约检' (Pending Inspection) in orange with a shopping cart icon, '提交选中' (Submit Selected) in blue with a checkmark icon, and a partially visible green button. A red rectangular box highlights the '加入待约检' and '待约检' buttons. Below the buttons, there are two columns: '准确度等级' (Accuracy Grade) and '使用区域' (Usage Area) with a dropdown arrow.



♥ 注意事项

6、从原市平台迁移到省平台的数据，部分仪器的【检定方式】有误，发起预约检定时，请确认是否与实际相符；如需修改，可在【仪器管理】的【全部仪器】检索出相应器具，点击【编辑】修改【检定方式】，保存即可。

首页 > 仪器管理 > 编辑仪器

仪器信息

* 器具名称	加气机(测试)	* 型号规格	JQ060L-E-6G
测量范围	10-60L/min	准确度等级	±1.0%
* 出厂编号	12345A	自编号	G51
* 生产厂家	合肥精大仪表有限公司	生产地	国产
* 安装使用地点	广州市xx区xx路xx号xx		
购买日期	请选择购买日期		
器具状态	启用	器具用途	贸易结算
器具类型	工作计量器具		
* 检定方式	现场		
* 类别	送检		
* 使用区域	广东省 / 广州市 / 天河区	* 种别	加气机
检定机构	广州能源检测研究院	器具编码	22010600015887
型评证书号			
有效期至	请选择有效期		
备注	请输入备注		

自定义标签 请输入自定义标签, 多个标签用空格隔开

相关资料 选择文件 未选择任何文件

请上传相关资料, 仅支持扩展名为.jpg, .jpeg, .png, .pdf, .zip, .rar等的文件格式, 总文件大小不可超过10M.

选择文件 未选择任何文件



♥ 注意事项

7、批量操作：如批量更新地址、批量停用、批量报废等

先检索出需要更新/停用/报废等的器具，并导出为Excel，整理Excel数据，点击相应的批量功能，选中已经整理好的Excel，设置起始行号和需要导入的行数，点击【确定】按钮。

未备案/在检/已停用/已报废的器具不能操作。

广东省计量强制检定管理平台

首页 > 仪器管理 > 全部仪器

按条件检索出器具信息

请输入仪器名称 请输入型号规格 请输入出厂编号

+ 添加 × 删除 清空 停用 报废 导入 更多导入

☐	#	操作	器具名称
☐	1	查看 编辑 复制	LNG加气机
☐	2	查看 编辑 复制	加气机(测试)
☐	3	查看 编辑 复制	加气机(测试)
☐	4	查看 编辑 复制	加气机(测试)
☐	5	查看 编辑 复制	加气机(测试)

更多导入

- 逐行导入
- 批量更新
- 更新地址
- 更换加油枪
- 批量停用
- 批量报废

2 导出器具信息Excel

3 在Excel上整理好数据后，再点击相应导入内容，完成批量操作。



♥ 注意事项

8、存在大量重复器具信息，无法正常使用操作的，先在【仪器管理】的【全部仪器】中导出全部器具信息的**Excle**表，**妥善保存表格数据后**，联系检定机构反馈给省局删除系统内全部器具信息。然后在导出的**Excle**表上进行删减和修改，留下需要保留的器具信息，再批量导入系统即可。

广东省计量强制检定管理平台

首页 > 仪器管理 > 全部仪器

请输入仪器名称 请输入型号规格 请输入出厂编号 请输入唯一标识

+ 添加 × 删除 清空 停用 报废 导入 更多导入 模板 导出


☐	#	操作	器具名称	出厂编号	型号规格
☐	1	查看 编辑 复制	LNG加气机	A058	JQO60L-E-6G
☐	2	查看 编辑 复制	加气机(测试)	12345A	JQO60L-E-6G

2 导出全部器具信息的Excle表格，妥善保存。



♥ 注意事项

9、在市平台选择的检定机构是能源院，到了省平台后变成计量院，无法正常发起预约检定的，可以先在【仪器管理】的【全部仪器】找到该器具操作**停用**，再在【备案管理】的【已停用】里面操作启用时，可以重新选择检定机构，但是需要重新备案。（注意：不要误操作为报废，否则无法恢复）

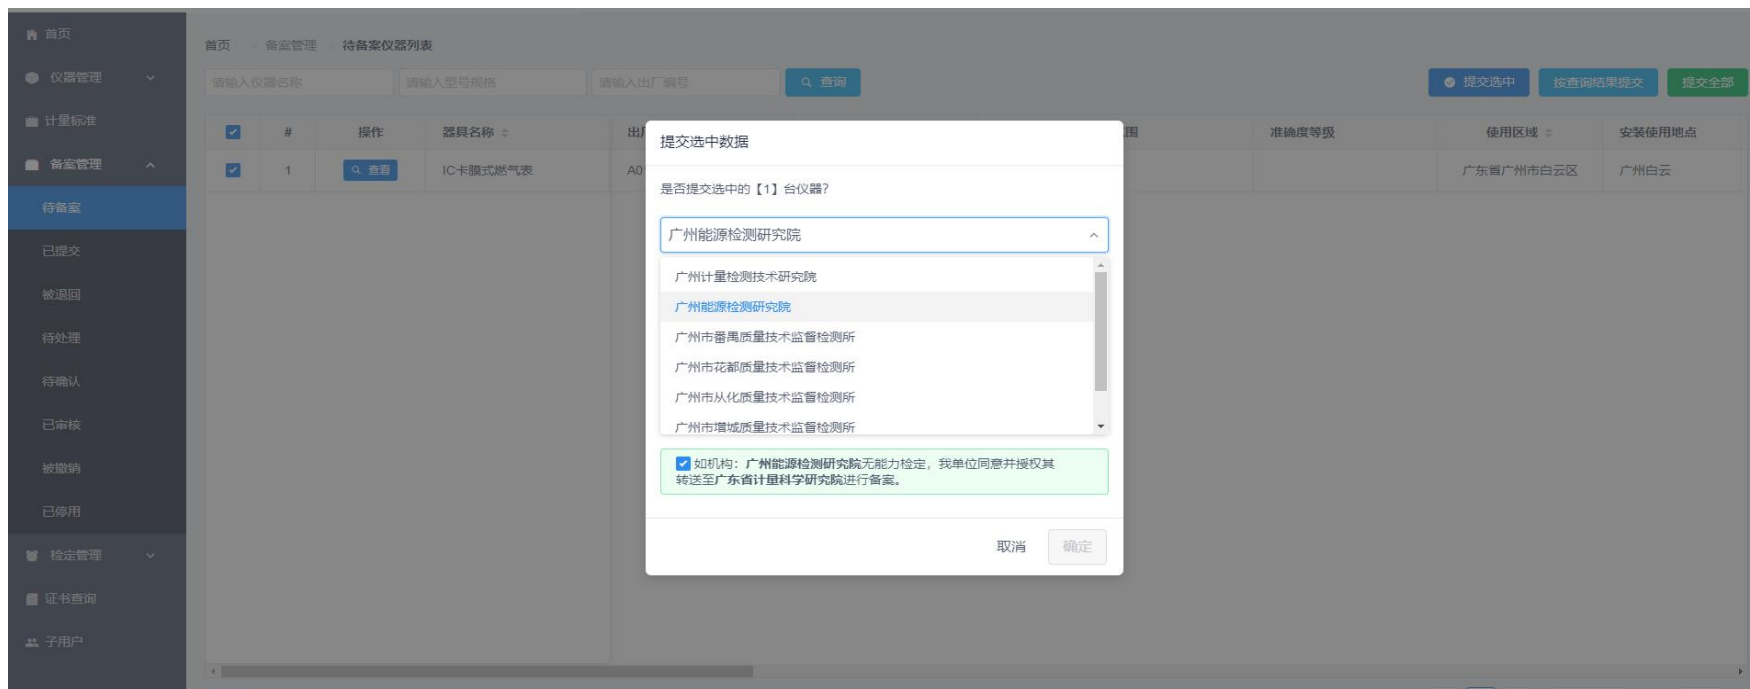



♥ 注意事项

10、账号登录异常情况，检定机构无法重置密码，需企业自行处理：


①用户连续登录失败5次，处于浏览器限制登录

解决办法：关闭浏览器，再打开，再登录或在浏览器中清理缓冲，再登录。

②用户连续登录失败10次，用户即被平台锁定，不能登录

解决办法：在登录页，点击【忘记密码】，取回或重置密码后，自行解锁。

③企业详情账号状态【允许使用】写着“禁用”的操作方式同【忘记密码】。

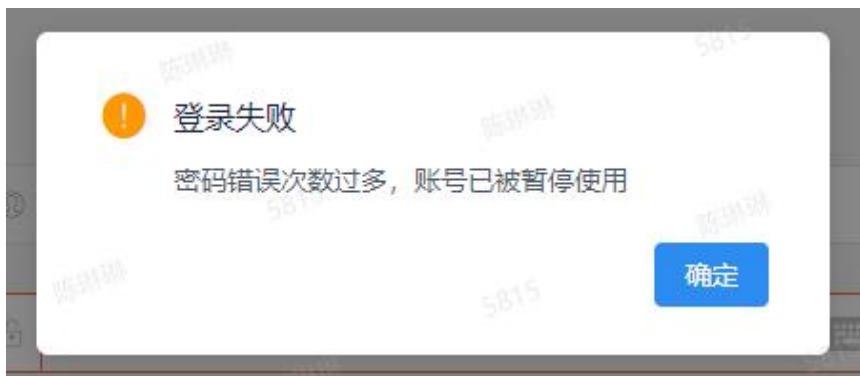



♥ 注意事项

11、《诚信计量自我承诺书》，需加盖公章、法定代表人（负责人）签名、日期，必须每年更新承诺一次，到期系统会弹窗提醒。

诚信计量自我承诺

您当前没有进行过诚信计量自我承诺，或距上次承诺已满一年，是否进行承诺？

取消 确定

诚信计量承诺

上传已填写并加盖公章后的承诺书扫描件

选择文件 未选择任何文件

请先下载承诺书模板 填写完毕后盖章，拍照或扫描回传，仅支持扩展名为.jpg,.jpeg,.png,.pdf等的文件格式，总文件大小不可超过10M。

如已上传过承诺书，可直接点击【承诺】按钮。

点击下载模板填写

承诺

诚信计量自我承诺书

为营造诚实守信的市场环境，维护公平竞争的市场秩序，确保商品或服务的计量准确性，本单位郑重承诺如下：

- 一、自觉遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》等计量法律法规规定，认真执行行业相关诚信计量管理规范要求。
- 二、建立健全和落实计量管理制度，加强计量业务培训。
- 三、使用符合要求的计量器具，不使用国家明令淘汰或者禁止使用的计量器具。
- 四、正确使用国家法定计量单位，明码标价，不利用计量手段欺骗消费者；坚决抵制破坏计量器具准确度、伪造计量数据等违法行为。
- 五、积极处理消费者的计量投诉
- 六、规范日常经营行为，积极配合计量监督检查。

本单位严格履行以上承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任，欢迎社会各界监督。

本单位监督电话：

投诉举报电话：12345

法人签名，或授权代理人签名

承诺单位（盖章）：盖公司公章

法定代表人（负责人）签名：

时间： 年 月 日