
Dyna-Form® Mercury Advance

これはDyna-Form Mercury Advanceシステムのクイックリファレンスガイドです
(追加情報については、ユーザーマニュアルを参照してください)。
製品コード MAT/ADV/198/88/12





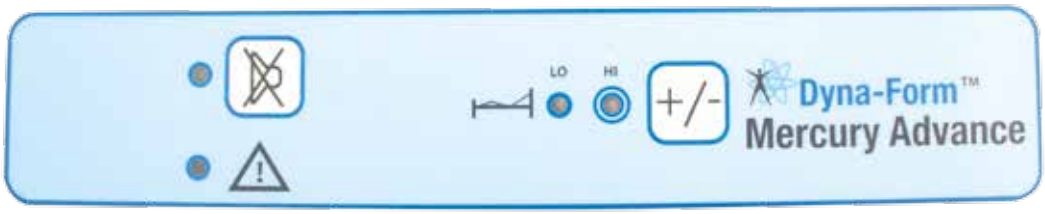

電源スイッチ警告音リセット

電源スイッチはポンプの主電源のオン/オフを切り替えます。

ポンプが検知した警告音は以下の手順で消音することができ、その後ポンプスイッチをオフにしてから再度オンにすることでリセットできます。



CPR弁

マットレスを膨らます前に、CPRコネクタがホーム状態になっていることを確認して下さい。
注: そうでないとマットレスは適切に膨らみません。

CPRコネクタは臨床的緊急時以外には使用すべきではありません。ただし、この機能を無効にすると、移動/固定モードの準備処置としてマットレスから急速に空気が抜けます。

LEDモード設定



電源オン/オフ
完全動的/より安定した設定

このマークが点灯している場合、マットレスがオンになっていることを示しています。
選択を解除するとオフになります。

これらの機能に関しては、メーカーからのアドバイスを受けることができます。
患者様が不快感を覚えたり、サポート表面が柔らかすぎたり不安定な場合など、患者様が完全に動的な機能を必要とされる場合、あるいはより高圧力のセルを必要とされる場合に、"Hi"設定(圧力26mmHg)を選択してください。圧力が高すぎると一部の患者状態にさらに悪影響を及ぼす可能性があるため、訓練を受けた臨床医以外はこの操作をしないでください。



Lo/快適圧力設定

患者様が不快感を覚えたり、セルの移動に非常に敏感であったり、さらなる発赤が生じているために、より低圧力のセルが必要な場合は、"Lo"を選択してください。訓練を受けた臨床医以外はこの操作をしないでください。



警告音の消音

この機能は警告音を取り消すために使用されます。警告音が取り消されたものの、異常が依然として検知されている場合にはLEDが点灯したままになります。完全にリセットするには上記の通りに電源スイッチを操作してください。警告音とランプの点灯が繰り返される場合は、エンジニアを呼ぶ必要があります。



警告音の異常

このシンボルは「警告音の異常」を示しています。
リセット方法については以下のトラブルシューティングガイドを参照してください。

注:マットレスのベース上のすべての固定ストラップがベッドフレームの非可動パーツ上に固定されていることを確認してください。

現象	問題 / 原因	確認事項
低圧力	マットレスがやわらかすぎるモードに設定されている。	モードボタンを標準（LoからHi (+) のより高圧設定）に変更します。5〜10分たってもやわらかすぎる場合は、エンジニアにご相談下さい。
	CPRコネクタが完全にホーム状態になっていない。	マットレス内ですべてのチューブがねじれていないか確認して下さい。
	システムに漏れがある可能性がある。	マットレス内のチューブが完全に接続されていることを確認します。
高圧力	マットレスが恒常的に硬すぎる。	マットレスを臨床的に必要な、より柔らかい設定にします。 5〜10分後に、マットレスが「より柔らかく」なっているか確認します。 なっていない場合は、エンジニアを呼ぶ前に以下の手順を確認して下さい。 注意：すべてのチューブがマットレス内でねじれていないか確認して下さい。

サービスソリューション

Direct Healthcareのサービスソリューションは、完全なご安心を24時間常に提供します。英国全土に拠点を擁し、お客様の元に迅速にお届けすることができます。お客様がお求めのサービスがベッドやマットレスのレンタルでも、除染作業や更に複雑なサービス手順でも、病院全体や在宅のニーズでもご要件に合わせてサービスを提供します。

弊社のユニットは、迅速かつ効率的に最も複雑なエンジニアリング・タスクに対処できるよう装備されています。



Direct Healthcare Services
Delivering the Promise

Direct Healthcare Services Ltd
Unit 6/10 Withey Court, Western Industrial Estate
Lon-y-Llyn, Caerphilly, CF83 1BF UK

営業所 +44 (0) 845 459 9831 ファックス +44 (0) 845 459 9832
メール info@directhealthcareservices.co.uk
www.directhealthcareservices.co.uk

Direct Healthcare Services Ltdは印刷された通りの正確な仕様を提供するよう万全を期しておりますが、予告なしに使用を変更する権利を留保します。このマニュアルに記載されたすべての機器とその情報は、適切な臨床判断と看護手順と組み合わせて使用する必要があります。
全製品の製造は、以下の規格に準拠しています：