“亞瑟”美固磁波治療器
“ASA” Magneto Therapy QS Device

衛部醫器輸字第 034207 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

■ 產品型號：Easy QS、PMT QS

■ 產品敘述：本產品包含 Easy QS 及 PMT QS 電子醫療設備，利用極低頻電磁場提供治療。

■ 產品用途

- 緩解肌肉疼痛。
- 促進局部血液循環。

■ *禁忌症：*

以下情況不建議應用磁場：

- *癌症患者。*
- *孕婦和兒童，因為沒有足夠大規模臨床試驗能夠證明這些受試者治療的絕對安全性。*
- *臨床情況不穩定的患者（例如：急性階段的感染性疾病、活動性出血、心臟疾病補償不足、一般情況惡化等）必須始終由處方醫師仔細評估。*

注意：不得治療裝有電子輔助器患者或對磁場敏感的患者，例如心臟節律器、胰島素幫浦或其他電子植入物。戴有助聽器的患者必須先將其移除。

■ *可能的副作用：*

從未發生過嚴重的副作用。根據該領域專家醫師的臨床研究結果，應監測高血壓或低血壓患者的動脈壓，但僅適用於“全身”磁療。 在罕見的情況下，可以觀察到短暫的且可逆的“過敏”，表現為精神過敏、易怒及失眠。 如果嚴格遵守禁忌症，則很少發生而且很容易確定預防措施。

■ *病患選擇：*

磁療適合成人患者。不建議兒童及孕婦使用，因為沒有針對這些對象的大規模臨床研究。

■ *治療建議：*

- *為了避免病菌與患者之間以及其他任何過敏性問題之間的傳播，不要將配件直接放置在患者的皮膚上。*
- *患者應該穿著衣服進行治療。*

- *在治療過程中，患者不得配戴對電磁場敏感的金屬製品或物體，例如鍊子、扣子、手錶等。*
- *無法在沒有中斷的情況下連續使用本產品。*
- *本產品具有 4 種預設程序。*

■ *安全注意事項：*

機械安全

- *將本產品放在水平面上。*
- *如下圖所示移動本產品：*

	
正確移動	*錯誤移動*

警告：患者必須仰臥在治療床上，將手放在身體上，不得跌落到一邊。

電性安全

- *安裝本產品時，應確保在連接到主電源後易於插拔插頭。電源插座必須距本產品位置的 3 米之內。*
- *檢查電源供應是否符合電氣規格、室內的電氣系統是否符合在醫療使用環境中安裝的當地標準。使用供應的電纜和/或電源裝置連接電源。*
- *電源線請勿插入延長線和/或適配器。*
- *請勿將本產品與治療床連接延長線。*
- *確保電源插座上具備有效的接地保護線。*
- *將電源線連接本產品之後再供電。*
- *從插座斷開本產品的連接時，請當心不要拉扯電源纜線；且從主電源上斷開插頭時，請勿拉扯電源纜線。*
- *在將電源線連接到本產品之前，請確保將本產品的常規開關轉到 O。*

警告：

- *不可改造本產品。*

- *為避免觸電危險，必須僅將本產品連接到具有保護性接地的電源插座。*
- *本產品的隔離電源在電源插頭中。因此，請確保電源插頭始終可用。*
- *適當安置本產品，讓患者無法碰觸產生器的圓柱接頭。因此，必須將產生器放置在離治療床至少 70 公分的位置。*
- *操作人員不得同時觸碰圓柱接頭及患者。*

其他警告及注意事項詳見原廠使用手冊。

■ 清潔與消毒：

定期清潔和消毒本產品及所連接的配件外部。

警告：必須在關閉本產品電源並斷開電源線的情況下進行所有清潔和消毒操作。

1. 用軟布沾不易燃、不含酒精的消毒劑清潔主機、治療床和圓柱。
2. 用乾淨的布清除清潔劑。

■ 產品規格：

本產品連接配件可以產生具有高達 100Hz (±5%)脈衝重複頻率的脈衝磁場。磁場的強度和空間佈局取決於所用配件的類型。

- 電氣規格

  主機與電動式治療床必須連接到能夠提供 100 到 240 V~ ±10%、頻率 50 或 60 Hz 的電源，接地連接必須有效。Easy QS 主機的最大功耗為 40-175 VA、PMT QS 主機的最大功耗為 60-270 VA、PMT QS 治療床的最大功耗為 55-65 VA。

- 物理規格

重量	3kg
尺寸	寬 28cm X 深 38cm X 高 13cm

- 環境規格

  本產品及其配件可在 0°C 至+ 40°C 的溫度範圍內、相對濕度在 30%至 75%的範圍內正確運行。可在-10°C 至+ 50°C 的溫度範圍內儲存。

■ 配件規格：

產品編碼	規格
F9020118	螺線管 Ø80 cm、深 40 cm 治療床尺寸(長 x 深 x 高): 188 x 55 x 72 cm
F9020120	可攜式螺線管 (Ø x 深): 50 x 34 cm (含握把及支架)
F9020119	可攜式螺線管 (Ø x 深): 30 x 21 cm (含握把及支架)
F9020073	Flexa 裝療器，尺寸(長 x 深 x 高): 36 x 21 x 2 cm

■ 磁場測量：

參考測量值 (請連繫原廠以獲取有關測量模式的訊息)

	頻率(Hz)	強度(%)	高斯(G)
圓柱 Ø30	25	100	60.2 - 90.2
圓柱 Ø50	25	100	52.2 – 78.2
圓柱 Ø80	25	100	24.5 – 36.7
Flexa 裝療器	25	100	33.4 – 50.2

■ 產品清單：

Easy QS		
項目	編碼	數量
Easy QS主機	F9020112	1
Flexa 裝療器	F9020073	2
攜帶箱	F9000069	1
鬆緊帶	M1090059	2
Flexa 纜線	D501089#	2
保險絲 2AT	---	2

Generator PMT QS		
項目	編碼	數量
PMT QS主機	F9020113	1
攜帶箱	F9000069	1
保險絲 4AT	---	2

PMT QS Simple Manual		
項目	編碼	數量
PMT QS主機	F9020113	1
台車	F9000215	1
手動式PMT QS治療床	F9020117	1
攜帶箱	F9000069	1
保險絲 4AT	---	2

PMT QS Simple Automatic		
項目	編碼	數量
PMT QS主機	F9020113	1
台車	F9000215	1
電動式PMT QS治療床	F9020116	1
攜帶箱	F9000069	1
保險絲 4AT	---	2
保險絲 1A	---	2

PMT QS Manual		
項目	編碼	數量
PMT QS主機	F9020113	1
台車	F9000215	1
手動式PMT QS治療床	F9020117	1
Flexa 裝療器	F9020073	2
攜帶箱	F9000069	1
鬆緊帶	M1090059	2
Flexa 纜線	D501089#	2
保險絲 4AT	---	2

PMT QS Automatic		
項目	編碼	數量
PMT QS主機	F9020113	1
台車	F9000215	1
電動式PMT QS治療床	F9020116	1
Flexa 裝療器	F9020073	2
攜帶箱	F9000069	1
鬆緊帶	M1090059	2
Flexa 纜線	D501089#	2
保險絲 4AT	---	2
保險絲 1A	---	2

製造廠名稱 : ASA s.r.l.
製造廠地址 : Via Galileo Galilei 23, 36057 Arcugnano (VI), Italy
藥商名稱 : 蓋婭基因股份有限公司
藥商地址 : 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

彩色圖片



PMT QS / Easy QS 主機



Flexa 裝療器



攜帶箱



鬆緊帶



Flexa 纜線



螺線管 Ø 80 cm


PMT QS 治療床 (手動或電動式)



可攜式螺線管 Ø 50



可攜式螺線管 Ø 30

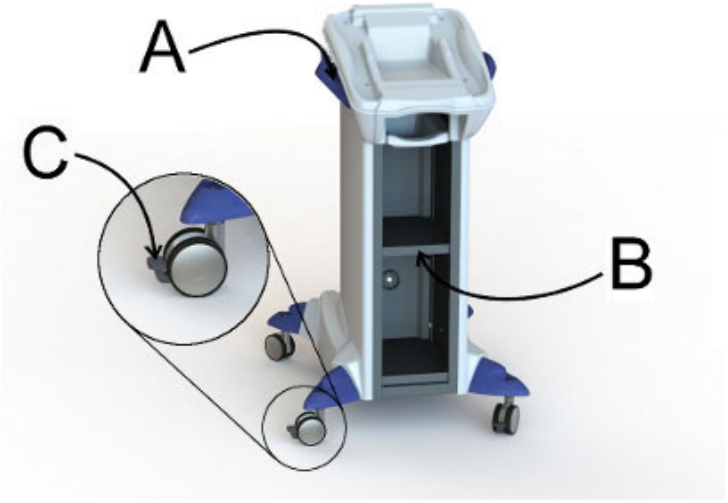

A: 台車把手
B: 置物艙
C: 煞車腳輪

台車