



用户手册

N8336 系列超高精度多通道电池模拟器

恩智(上海)测控技术有限公司

2022-09-02

版本: V1.3

版权说明

恩智（上海）测控技术有限公司（简称：恩智（NGI））

未经恩智（NGI）允许和书面同意，不得以任何形式（包括电子存储和检索或翻译为其他国家地区语言）复制本手册中的任何内容。

恩智（NGI）对使用或应用本文档及其包含的任何信息所引起的损失不承担相关责任。

本手册提供的信息如有变更，不另行通知，可自行到本公司网站下载，网址为 [Http://www.ngitech.cn](http://www.ngitech.cn)。

注：本手册所涉及产品均符合 ISO9001:2015 认证标准。

联系我们

如果您对本产品有任何疑问，请根据以下方式进行联系。

- 1、服务热线：400-966-2339
- 2、官方邮箱：sales@ngitech.cn
- 3、恩智（NGI）网站：Http://www.ngitech.cn

目录

一、前言	1
二、安全说明	3
2.1 安全须知	3
2.2 安全标识	4
2.3 使用环境	5
三、产品介绍	6
3.1 简介	6
3.2 机型概览	7
3.2.1 开箱检查	7
3.2.2 开机检查	8
3.3 机箱外观、尺寸	9
3.4 前面板介绍	10
3.4.1 键盘介绍	10
3.4.2 功能键	11
3.4.3 数字、电源、选择键	12
3.4.4 旋钮	12
3.5 后面板介绍	14
3.5.1 通道端口	14
3.5.2 串口（RS485）	15
3.5.3 CAN 端口	16
3.5.4 网络端口（LAN）	16
3.5.5 出厂参数	17
3.6 产品接线	17
3.7 远程模式	18
3.7.1 RS485 总线通信	18
3.7.2 CAN 总线通信	18
3.7.3 LAN 通信	18
3.7.4 LAN 故障排除	19
四、软件安装及使用介绍	20
4.1 软件运行环境	20
4.2 测控软件安装及卸载	20
4.2.1 安装	20
4.2.2 卸载	21
4.3 与上位机（PC）连接方法及准备工作	21
4.3.1 端口连接	21
4.3.2 禁止操作系统待机模式	22
4.3.3 设置网络 IP 地址段	23

4.4 软件主界面	29
4.5 操作前配置	30
4.5.1 硬件配置	30
4.5.2 高级配置	31
4.5.3 联机/断开	31
五、功能及操作	32
5.1 界面介绍	33
5.2 电源模式	34
5.2.1 参数设定	34
5.2.2 操作步骤示例	35
5.2.3 远程操作控制指令示例	36
5.3 充电模式	37
5.3.1 参数设定	37
5.3.2 操作步骤示例	37
5.3.3 远程操作控制指令示例	38
5.4 SOC 编辑	39
5.4.1 参数设定	39
5.4.2 操作步骤示例	40
5.5 SOC 测试	42
5.5.1 参数设定	42
5.5.2 操作步骤示例	43
5.5.3 远程操作控制指令示例	44
5.6 序列编辑	45
5.6.1 参数设定	45
5.6.2 操作步骤示例	47
5.7 序列测试	48
5.7.1 参数设定	48
5.7.2 操作步骤示例	49
5.7.3 远程操作控制指令示例	50
5.8 实时曲线	51
5.9 通道回读	52
5.10 系统配置	53
5.10.1 通讯设置	53
5.10.2 其它参数	54
5.11 CAN 设置	55
5.12 恢复出厂	56
5.13 关于我们	56
六、维护与校准	57
6.1 保修服务	57
6.2 保修限制	57

6.3 日常维护	57
6.4 故障排查	58
6.5 返厂维修	59
七、主要技术指标	60

一、前言

尊敬的用户：

非常感谢您选择恩智（上海）测控技术有限公司（以下简称恩智（NGI））N8336 系列超高精度多通道电池模拟器（以下简称 N8336）。以下为您做相关介绍：

关于恩智（NGI）

恩智（NGI）主要从事仪器仪表、电子产品、机械设备、自动测试系统、计算机软件、自动控制设备、自动监控报警系统的设计、安装、销售、维修、软件测试、从事货物及技术的进出口业务等。恩智（NGI）为智能设备与测控仪器专业制造商，始终秉持“以客户为中心，以奋斗者为本”的企业宗旨，致力于信息化制造、科学实验、教育科研等相关领域测控解决方案研究与探索。通过不断深入接触并了解各相关行业测控与电子电路技术需求，持续投入研发并向各行业合作伙伴提供具有竞争力的解决方案，恩智（NGI）已经拥有广泛的测控和电子技术类产品线，合作伙伴遍布多个行业领域。恩智（NGI）持续的研发投入和对产业发展的追踪，寄望于为客户提供贴心的技术服务和应用体验，为智能制造业发展做出应有的贡献。十年来，恩智（NGI）始终发扬“团结协作，勇攀高峰”的团队精神，不断推出尖端测控技术和产品，在多个领域保持技术领先地位。

恩智（NGI）跟多所高校和科研机构保持紧密合作关系，跟众多行业龙头企业保持紧密联系。恩智（NGI）努力研发高质量、技术领先的技术和产品，并不断探索新行业测控解决方案。恩智（NGI）作为国内知名电子电路与测控技术方案提供商，近年来影响力不断提高，其自主研发生产的系列超级电容测试仪器、系统、解决方案更是业界翘楚。感谢给予恩智（NGI）的相关支持，未来，恩智（NGI）将以最好的精神面貌去迎接更大挑战。

关于用户使用手册

本手册版权归恩智（NGI）所有，适用于恩智（NGI）N8336 系列超高精度多通道电池模拟器。内容包括 N8336 系列产品的安装、操作及规格等详细信息。由于仪器不断升级，本手册是以“现状”提供，且可能会在将来的版本中不经通

知而被修改。为实现技术上的准确性，恩智（NGI）已仔细审查本文件，但是对本手册包含信息的准确性不作任何明示或者默示的保证，并对其错误或是由提供、执行和使用本手册所造成的损害不承担相关责任。

为保证产品正确使用，请仔细阅读手册，特别是安全注意事项。

请妥善保管手册，以便使用时查阅。

二、安全说明

2.1 安全须知

本产品应由特定人员使用，此类人员需能够辨别电击危险，且熟悉必要的安全注意事项，从而避免潜在伤害。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵照所有安装、操作及维护信息。

产品用户类型包括：

安全责任主体，可以是个人或者部门，对设备的使用和维护负责，确保在设备规定和运行限制范围内使用设备，并确保操作人员经过充分培训。

操作人员只能将本产品用于预期功能。操作人员需经过电气安全措施培训和本仪器正确使用培训。操作人员应得到电击保护并且防止接触到危险的带电电路。

维护人员对产品执行日常维护以确保正常运行。例如，设置线路电压或更换耗材。用户文档中已经说明相关维护步骤，且清楚描述了操作人员是否能够执行。否则，只应由维修员执行。

维修人员经过培训，能处理带电电路，执行安全安装，以及修理产品。只有经过正确培训的维修员才能执行安装和维修步骤。

操作仪器之前，确保电源线连接到正确接地的电源插座上。每次使用之前，请先检查连接电缆、测试引线和跳线是否出现磨损、断裂或折断。

使用过程中存在电击危险时要格外小心。电缆连接器插孔或测试夹具可能存在危险电压。当电压超过 30 V RMS、42.4 V peak 或 60 VDC 时，存在电击危险，需做好防护。

在操作和使用仪器过程中，请严格遵守以下注意事项。不遵守以下注意事项或本手册中其它章节提示的特定警告，可能会削弱设备所提供的保护功能。

对于用户不遵守这些注意事项而造成的后果，将由用户自行承担。

表 2-1

请可靠接地	开启仪器前，请确认仪器可靠接地以防电击
确认保险管	确保已正确安装保险管
勿在危险环境中使用	请勿在易燃易爆环境下使用本仪器
勿打开仪器外壳	未经允许，请勿打开仪器外壳

2.2 安全标识

以下术语或符号标识会出现在本手册中或产品上：

备注/注意

备注/注意标志表示有提示。它要求在执行前操作步骤时需要参考，给操作员提供窍门或信息补充。

警告

警告标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时加以注意，指出可能会危害操作人员生命安全的条件和行为。在执行指定程序之前，请务必仔细阅读相关信息。

表 2-2

符号	意义	符号	意义
	直流电	N	零线或中性线
	交流电	L	火线
	交直流电		电源开
	三相电流		电源关
	接地		备用电源
	保护性接地		按钮开关按下
	接外壳或机箱		按钮开关弹出
	信号地		小心电击
WARNING	危险标志		高温警告
Caution	小心		警告

2.3 使用环境

表 2-3

使用环境	要求
工作温度	0℃-40℃
相对湿度	5%-90%（无结露）
存储温度	-20℃-60℃
海拔	<2000m
使用气压	80-110kPa
AC输入电压范围	220V±10%
频率	47Hz-63Hz

三、产品介绍

3.1 简介

N8336 系列为一款小功率、多通道、超高精度可编程单芯电池电压模拟器，也是一款超高精度多通道直流电源；电压精度高达六万分之一；单机容纳多达 16 个通道，且各通道间相互隔离，方便多通道串联使用。N8336 系列支持 nA 级电流测量；支持电源模式、充电模式、SOC 测试、序列测试、实时曲线等多种测试功能；支持本地/远程 (LAN/RS485/CAN) 控制，通讯响应时间 $\leq 10\text{ms}$ 。N8336 系列编程软件灵活易用、操作简洁，能满足多通道、多参数、复杂测试环境下测试的需求。

特点介绍

- 电压范围：0~5V/0~6V
- 电流范围：0~1A/0~3A
- 超高精度，电压精度达六万分之一
- 支持 nA 级电流测量精度
- 电压温度系数最优 20ppm/°C
- 单机多达 16 通道，通道间隔离，支持串联
- 支持 SOC 测试、序列测试、实时曲线等多种功能
- 16 通道通讯响应时间 $\leq 10\text{ms}$
- 4.3 英寸高清彩屏，本地/远程控制，专业测试软件
- 标准 LAN、RS485、CAN 通讯控制

3.2 机型概览

3.2.1 开箱检查

接收到产品后，请按以下步骤对设备进行检查：

- 1、检查运输过程中外包装是否损坏；
- 2、检查是否收到附件，附配件是否齐全，请参考表 3-1；
- 3、检查设备整机外观是否异常。

表 3-1

N8336附件	数量	说明
电源线	1	接入220V交流电源
保险管（250V/10A）	2	保险管
5.08-4P测试接头（带耳）	16	端子接线
3.5-3P绿色母头	1	测试接头，485通讯
3.5-5P绿色母头	1	测试接头，CAN通讯，触发功能
网络连接线	1	连接PC
U盘	1	用户手册、软件与技术信息
检测报告	1	产品检测报告
合格证	1	产品合格证明



注意

若存在缺失或损坏，则请立即与恩智（NGI）授权经销商或售后服务部门联系。在未获得肯定答复之前，请勿将设备寄回。

3.2.2 开机检查



为减少起火和电击风险，请确保该地区市电电压在工作电压范围内，并确定三芯电源线接地良好。

若设备不能正常启动，则可以尝试以下解决方法：

- 1、检查电源线是否接好，设备开关是否正常；
- 2、检查设备保险丝是否熔断，若保险丝熔断，则请用相同规格类型保险丝替换，避免引发事故。

表 3-2

型号	N8336 系列
保险丝规格	250V/10A/20×5/陶瓷

保险丝更换方法可按如下步骤进行：

- 1、关闭仪器，移除电源线。
- 2、使用小一字螺丝刀插入电源插口处的凹槽，轻轻撬出保险丝座。
- 3、取出保险丝，更换指定规格的保险丝。



为确保操作人员安全，更换保险丝前，请断开设备电源。

3.3 机箱外观、尺寸

N8336 系列产品尺寸：88mm(H)*482mm(W)*557mm(D)

以下是 N8336 产品尺寸图：

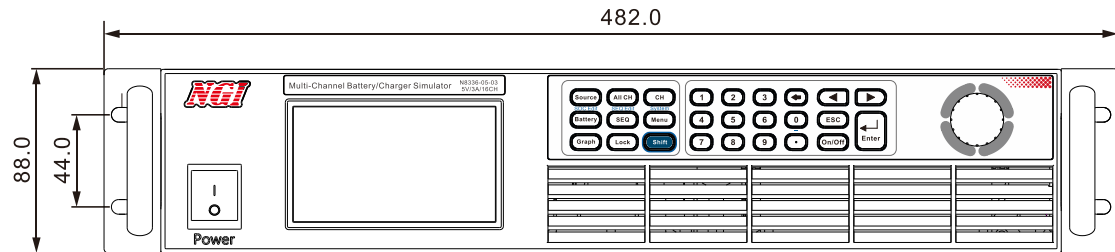


图 3-1 前面板尺寸

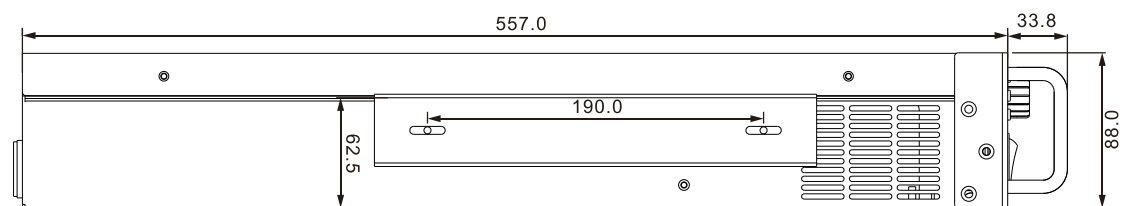


图 3-2 机箱侧视尺寸

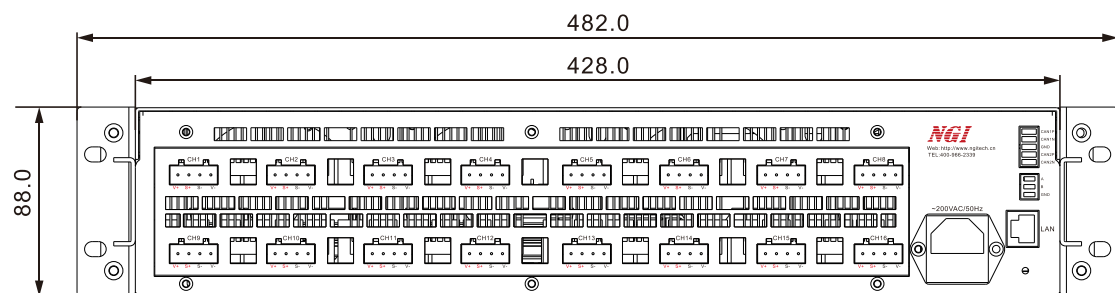


图 3-3 后面板尺寸

3.4 前面板介绍

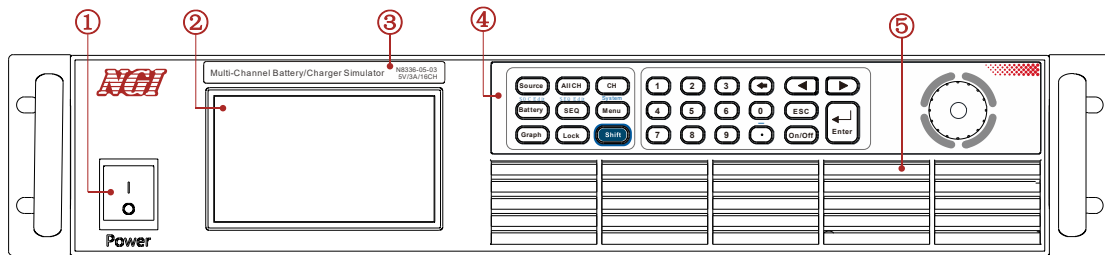


图 3-4 前面板

表 3-3 前面板说明

标识	名称	说明
1	电源开关	开启或关闭仪器电源
2	显示屏	显示相关信息
3	产品名称及型号	设备型号、规格参数
4	键盘	设置设备工作模式、参数
5	进风口	通风散热

3.4.1 键盘介绍

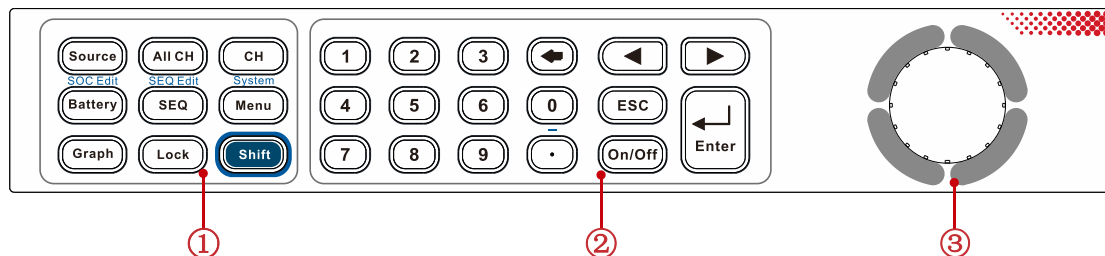


图 3-5 键盘

表 3-4 键盘功能介绍

标识	名称
1	功能键
2	数字键
3	调节旋钮

3.4.2 功能键

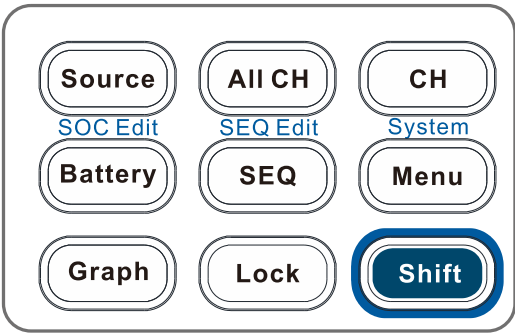


图 3-6 功能键

表 3-5 功能键介绍

按键	功能
Source	电源模式
All CH	通道回读
CH	通道切换按钮
SOC Edit Battery	电池模拟/SOC 编辑
SEQ Edit SEQ	SEQ 测试/SEQ 编辑
System Menu	功能菜单/系统配置
Graph	实时曲线
Lock	锁定/解锁键
Shift	第二功能切换键，长按此键为截屏操作

3.4.3 数字、电源、选择键

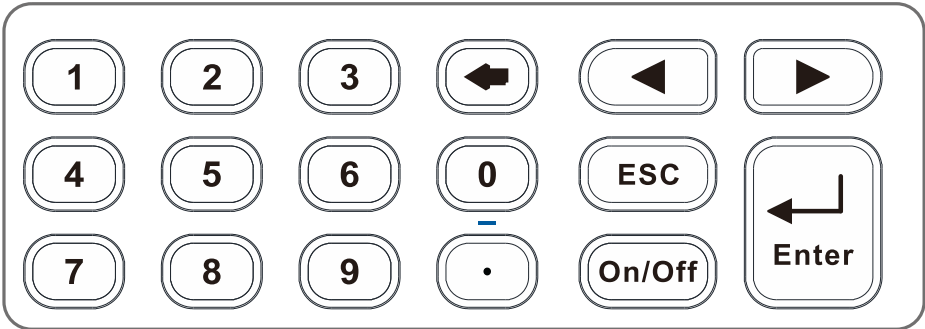


图 3-7 数字、电源、选择键

表 3-6 数字、电源、选择键介绍

按键	功能
1 ~ 9, .	数字编辑键
←	清除输入键
← →	左右移，移动光标到指定位置
↵ Enter	操作确认键
ESC	用于退出设置项或菜单
On/Off	On/Off 所选通道的电源输出

3.4.4 旋钮

N8336 选择旋钮，如图 3-8 所示：




图 3-8 旋钮

功能介绍如下：

- 1、调整数值设定；

- 2、选择菜单项/参数项；
- 3、确认设定值或选择菜单项/参数项。

调整数值设定

在数值设定界面中，顺时针转动旋钮将数值递增，逆时针转动旋钮将数值递减。

选择菜单项/参数项

旋钮可用来选择菜单项/参数项。在显示界面中，顺时针转动旋钮表示选中下一个菜单项/参数项，逆时针转动旋钮表示选中上一个菜单项/参数项。

确认设置

在完成数值设定或者选中某个菜单项之后，按压旋钮，即可执行确认操作。

3.5 后面板介绍

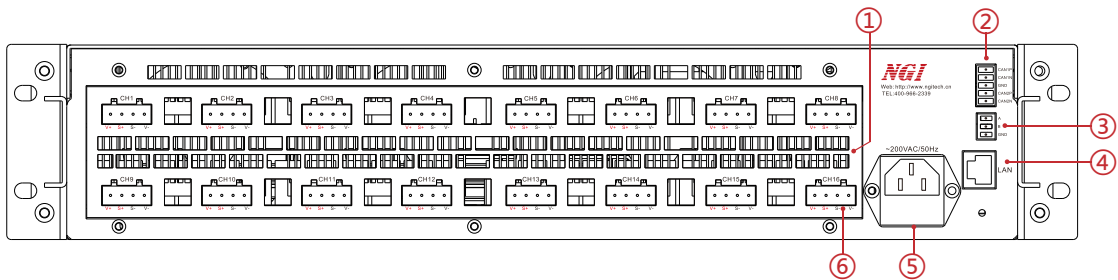


图 3-9 后面板

表 3-7 后面板说明

标识	名称	说明
1	出风口	通风散热
2	CAN 端口	可通过 CAN 通讯控制仪器设备
3	RS485 端口	可通过 RS485 通讯控制仪器设备
4	LAN 端口	可通过 LAN 通讯控制仪器设备
5	电源接线端口	给设备供电
6	通道端口	通道输出

3.5.1 通道端口

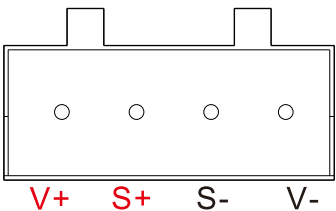


图 3-10

通道输出端口，其端口引脚定义如表 3-8 所示。

表 3-8

标识	说明
V+	四线制输出方式的正极输出
S+	四线制输出方式的正极采样端子
S-	四线制输出方式的负极采样端子
V-	四线制输出方式的负极输出



注意

输入端子 (+) 与 (-) 输入端子之间输入电压最大限值为产品规格电压*1.5
 输入端子 (+) 与 (-) 输入端子之间输入电流最大限值为产品规格电流

3.5.2 串口（RS485）

本设备配备一个 RS485 总线端口，RS485 端口用来对设备进行远程控制。

端口引脚如表 3-9 所示。




图 3-11 RS485 引脚标识

表 3-9

脚号	描述
A	信号 A
B	信号 B
GND	信号 GND

PC 可以通过 USB 转 RS485 转换器实现通讯控制，连接示意图如 3-12 图所示：

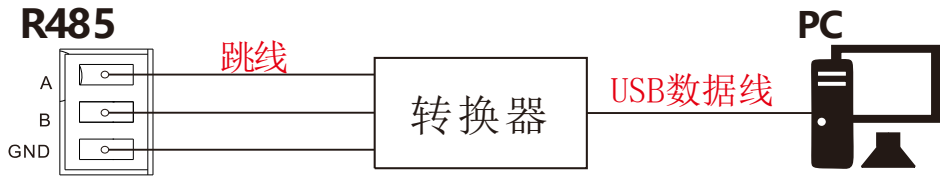


图 3-12

3.5.3 CAN 端口

本设备配备一个 CAN 总线端口，如图 3-13 所示。

端口引脚如表 3-10 所示。




图 3-13 CAN 引脚标识

表 3-10

脚号	描述
CAN1P	高电平
CAN1N	低电平
GND	接地
CAN2P	高电平
CAN2N	低电平

PC 可以通过 USB 转 CAN 转换器实现通讯控制，连接示意图如 3-14 图所示：

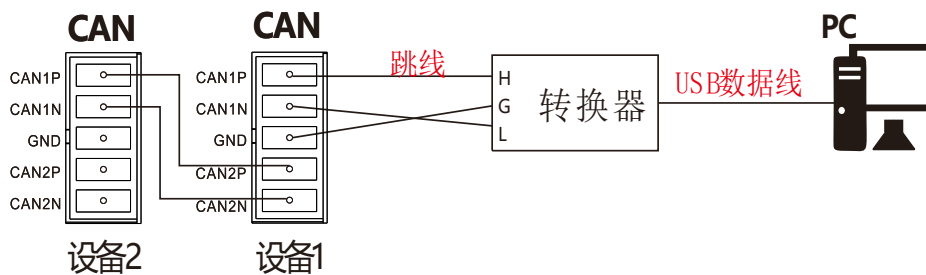


图 3-14

3.5.4 网络端口（LAN）

N8336 后面板有一个 LAN 端口，可通过双头网线将计算机与设备 LAN 端口进行连接，如图 3-15 所示。




图 3-15 LAN 端口



N8336 标配有三种通信控制端口：RS485、CAN 和 LAN 端口。用户可以任意选择一种来实现与计算机的通讯。

3.5.5 出厂参数

N8336 详细出厂设置参数如表 3-11 所示：

表 3-11

设置选项	N8336 默认参数
外部通讯接口 IP 地址	192.168.0.123
内部通讯接口，串口速率	115200

3.6 产品接线

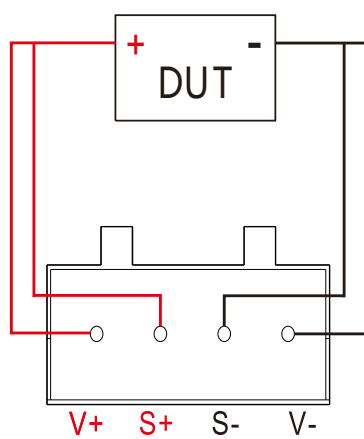


图 3-16 接线图

3.7 远程模式

远程模式界面如图 3-17 所示。

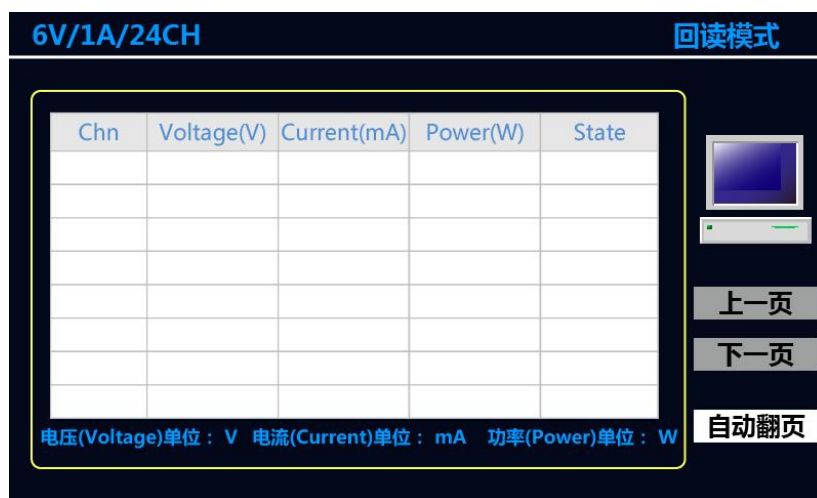


图 3-17 远程模式



注意

当设备与计算机断开连接后需要按“Lock”键解除锁定状态。

3.7.1 RS485 总线通信

RS485 总线通信指通过 USB 转 RS485 的转换器实现电脑通讯控制。

若使用 RS485 通讯，则请在“系统配置”界面下，先查看仪器中波特率配置大小，再对 PC 端设置相同波特率。

3.7.2 CAN 总线通信

CAN 总线通信可通过 USB 转 CAN 的转换器实现电脑通讯控制。

3.7.3 LAN 通信

LAN 通信指使用局域网通信（LAN）与仪器进行通信，使用网络电缆线连接。

当使用 LAN 连接时，可以使用上位机对仪器进行 IP 扫描，保存仪器 IP 后则可对仪器远程访问。



如果在设置 LAN 时遇到问题，请参阅 [LAN 故障排除](#)。

3.7.4 LAN 故障排除

上位机无法远程仪器时，请检查以下项：

- 1、请检查 PC 端与仪器网络电缆线连接是否松动。
- 2、确认以太网配置信息是否正确。
- 3、计算机以太网已启用。
- 4、仪器 IP 地址与 PC 端 IP 地址是否在同一网关。

四、软件安装及使用介绍

4.1 软件运行环境

推荐计算机配置：

- CPU：2.0G 双核以上
- 内存：4G 以上
- 硬盘：80G 以上
- 端口：网口
- 操作系统：Microsoft Windows 7 及以上

4.2 测控软件安装及卸载

4.2.1 安装

在 U 盘中找到“应用程序”文件夹中的“N8336_std_setup.exe”安装文件，双击此文件进入安装向导，按提示点击“下一步”，直到安装完毕，安装完成后桌面上会显示快捷方式图标。



图 4-1 相关资料

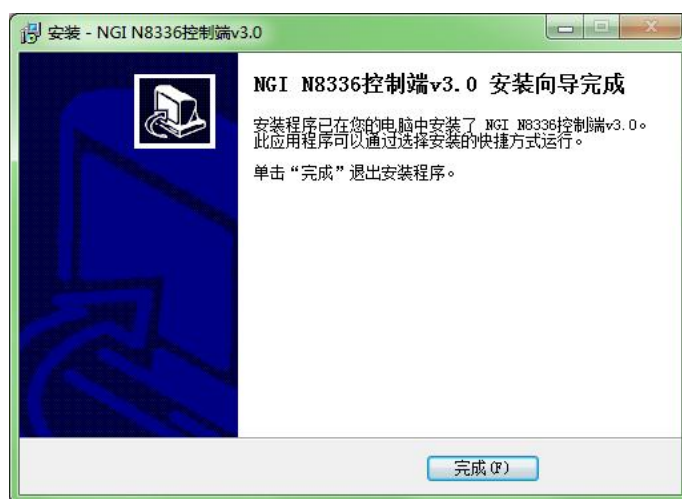


图 4-2 软件安装完成界面

4.2.2 卸载

进入计算机控制面板，点击“卸载程序”，找到目标程序，双击卸载程序。



图 4-3 卸载程序

4.3 与上位机（PC）连接方法及准备工作

4.3.1 端口连接

将网线一端插入 PC 网口，另一端插入设备 LAN 口，设备开机后进入系统配置界面，查看设备网络 IP，PC 端需设置相同网段 IP 才能搜索到设备。



图 4-4 系统配置界面图

4.3.2 禁止操作系统待机模式

■ Windows7 设置



图 4-5 电源选项设置

选择“开始”菜单，点击“控制面板”，进入“电源选项”。更改计算机睡眠时间，将“使计算机进入睡眠状态”修改为“从不”，完成后点击“保存修改”。



图 4-6 更改计算机睡眠时间

■ Windows10 设置

选择“开始”菜单，点击“设置”图标，进入 Windows 设置页面，然后点击“系统”。



图 4-7 电源选项设置

点击“电源和睡眠”，如图 4-8 所示，将以下选项修改为“从不”。



图 4-8 更改电源和睡眠设置

4.3.3 设置网络 IP 地址段

设备出厂网络 IP 为“192.168.0.XXX”（XXX 为 0~255 之间），在使用时，将 PC 端 IP 指定到设备相同网段。以下将 PC 端 IP 修改为“192.168.0.12”做说明。

■ Windows7 设置

选择“开始”菜单，点击“控制面板”-“查看网络状态和任务”-“本地连接”-“属性”，找到“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”，双击进行配置。



图 4-9 操作步骤



图 4-10 操作步骤

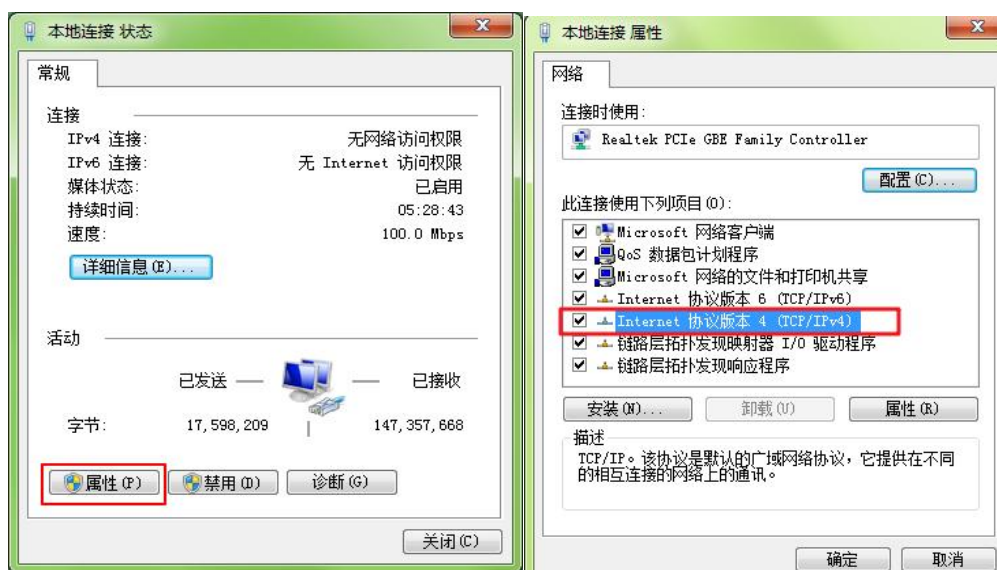


图 4-11 操作步骤

设置 PC 的 IP 地址和 DNS 服务器地址如图 4-12 所示，点击确定。

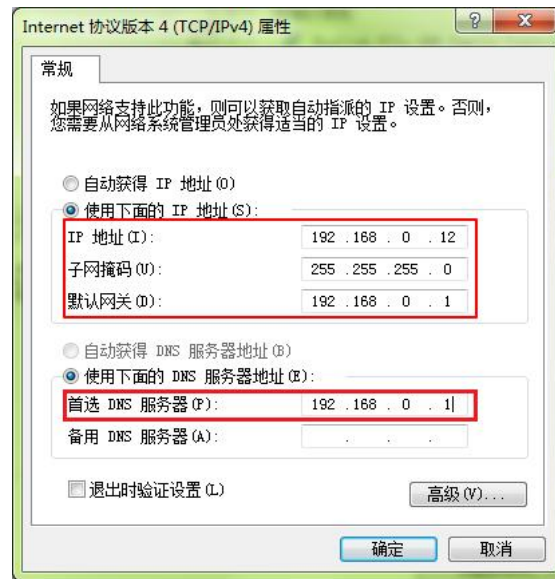


图 4-12 设置 PC 地址

设定成功后，查看设备和 PC 是否正常通信：

点击“开始”菜单，搜索“cmd”，点击“cmd.exe”，输入“ping 192.168.0.123”，执行。若设备正常通信，则返回如图 4-14 所示信息。

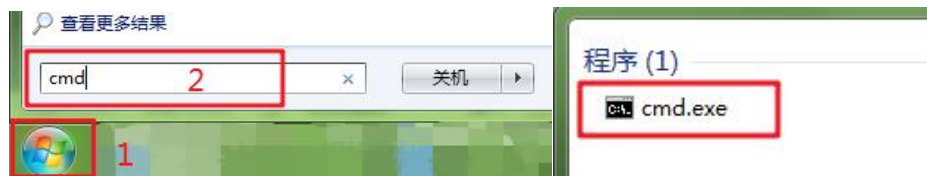


图 4-13 打开 cmd



图 4-14 测试通信是否正常

■ Windows 10 设置

选择“开始”菜单，点击“设置”-“网络和 Internet”按钮-“更改适配器选项”。



图 4-15 更改网络设置

然后选择相应网卡，右键点击“属性”。

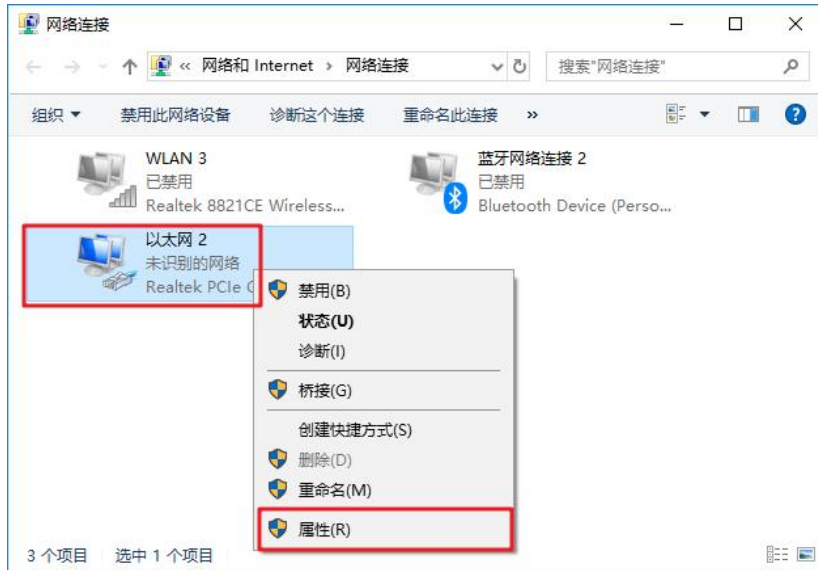


图 4-16 选择 PC 网卡

找到“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”，双击进入配置。

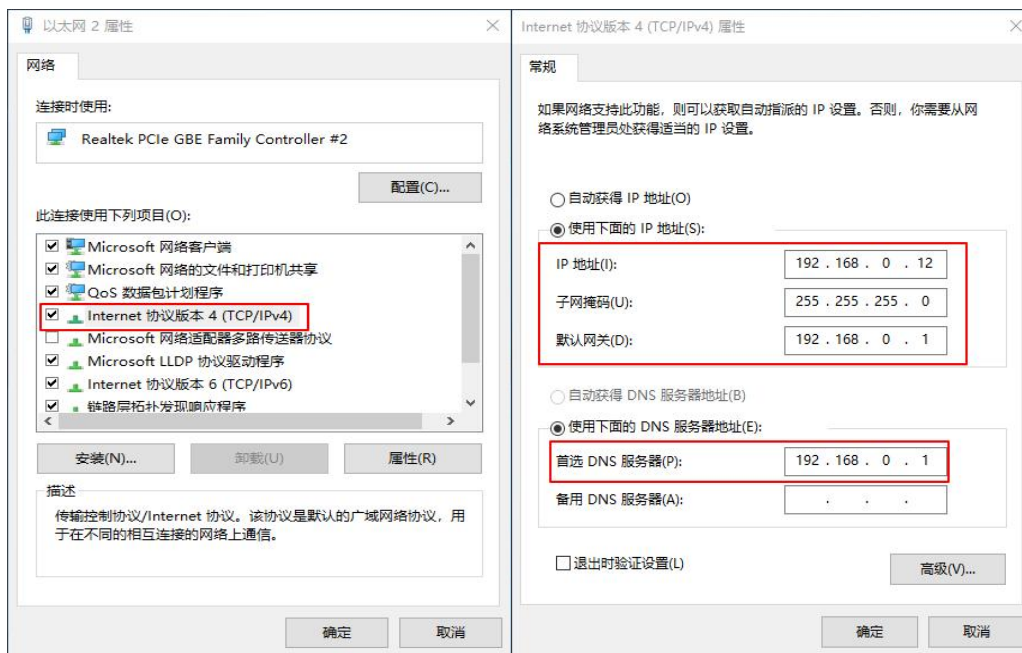


图 4-17 设置 PC 地址

设定成功后，查看设备和 PC 是否正常通信：

点击“开始”菜单，在 Windows 系统文件夹下点击“命令提示符”工具。

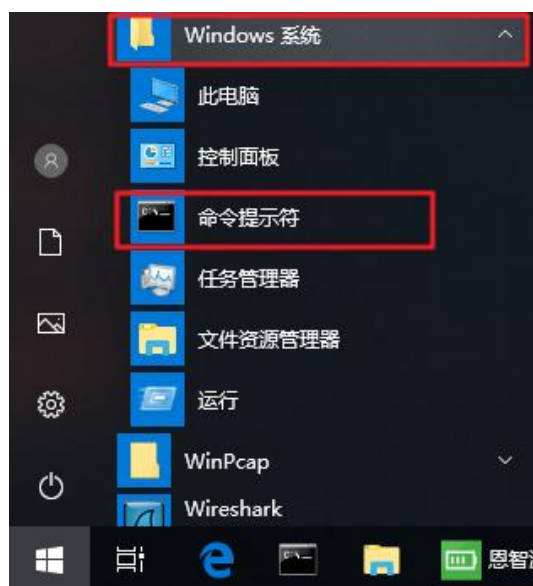


图 4-18 打开“命令提示符”工具

输入 ping 192.168.0.123，确认。若 PC 与设备可正常通讯，则返回如下信息。

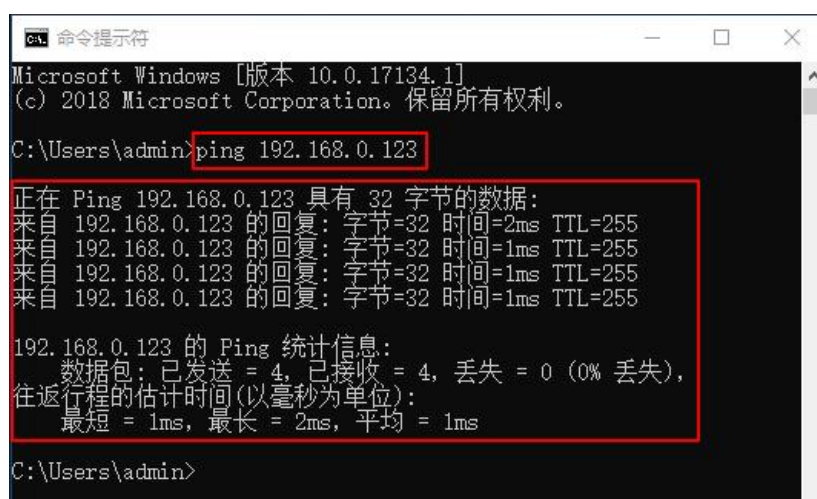


图 4-19 测试通信是否正常

4.4 软件主界面



图 4-20 软件图标

软件安装完成后，点击电池模拟器应用程序进入主界面。

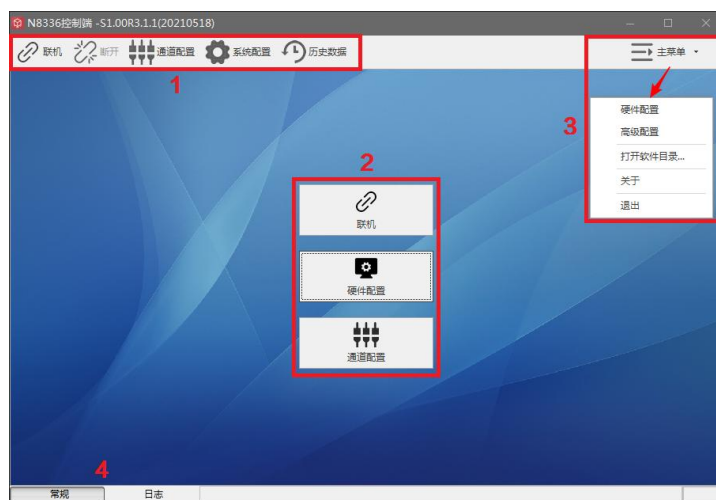


图 4-21 程序主界面

主界面介绍：

1、工具栏

包含联机、断开、通道配置、系统配置、历史数据、视图切换等常用功能。

2、快捷菜单

包含硬件配置、高级配置、打开软件目录、关于、退出功能。

3、主菜单

联机前相关配置。

4、日志

显示设备异常信息。

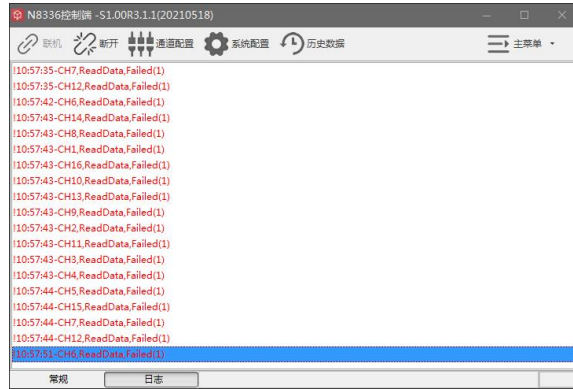


图 4-22 日志

4.5 操作前配置

4.5.1 硬件配置



图 4-23 硬件配置

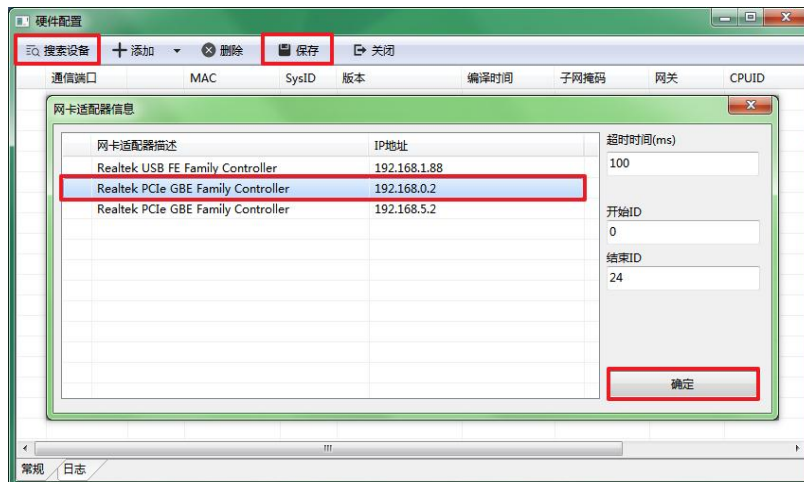


图 4-24 搜索设备

操作步骤：

- 1、点击主界面硬件配置进入硬件配置界面。
- 2、通讯方式选择“LAN”，输入目标 IP。
- 3、点击“搜索设备”，选择 PC 网卡的 IP 地址段，点击“确定”。
- 4、等待搜索完毕，出现可用设备。
- 5、点击“保存”。

4.5.2 高级配置

点击工具栏的“主菜单”，选择“高级配置”选项，即进入高级配置界面。

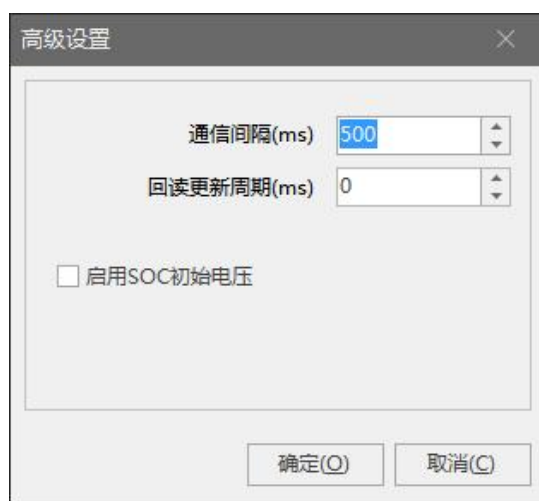


图 4-25 高级配置

- 通信间隔：指定获取电压、电流值的时间间隔。
- 勾选“启用 SOC 初始电压”，可在 SOC 功能中设定 SOC 初始电压参数。

4.5.3 联机/断开

“联机”指软件与设备建立连接，联机状态才可正常控制设备。“断开”指中断连接，即通信中断。



图 4-26 联机/断开

五、功能及操作

设备开机后进入“电源模式”界面，按“Menu”键进入到主菜单界面。主菜单界面包括“电源模式”、“充电模式”、“SOC 测试”、“SOC 编辑”、“序列测试”、“序列编辑”、“实时曲线”、“通道回读”、“系统配置”、“CAN 设置”、“关于我们”、“恢复出厂”这 12 个子菜单。



图 5-1 主菜单界面

本章节将详细描述 N8336 的功能及操作，主要分以下几个部分：

- 电源模式
- 充电模式
- SOC 编辑
- SOC 测试
- 序列编辑
- 序列测试
- 实时曲线
- 通道回读
- 系统配置
- CAN 设置
- 关于我们
- 恢复出厂

5.1 界面介绍

N8336 电池模拟器初始化及自检完成后，进入开机主界面。如图 5-2 所示：



图 5-2 界面介绍

表 5-1

标识	说明
1	型号标识
2	通道回显：包括电压、电流、功率、容量值 可按“Shift”+“←→”组合切换
3	状态标识：包括 ON/OFF 状态、功能模式
4	功能模式
5	参数设定区域

5.2 电源模式

N8336 设备开机后，默认进入“电源模式”，具有恒压限流功能。

用户按“Source”键进入“电源模式”界面，或在“Menu”菜单下选择“电源模式”进入界面，界面显示如图 5-3 所示。



图 5-3 电源模式

5.2.1 参数设定

■ 通道选择

通道选择是指选择当前编辑参数或者运行当前通道，进入电源模式，可以使用以下两种方法进行通道选择：

- 1、直接按“CH”键对通道进行切换；
- 2、按“←→”键或旋转“旋钮”移动光标至“通道选择”选项，按下“旋钮”选中，进入通道选择界面，旋转“旋钮”或按“←→”键在下拉菜单中选择目标通道，再按下“旋钮”即可选中该通道。



注意

可用“Enter”按键替代按下“旋钮”做选中操作，两者等效。

■ 电流量程

“电流量程”为电流回读量程，包括大量程、小量程、自动量程选项。设置为自动量程时，回读电流量程根据实际电流值自动切换量程，切换量程后需重新 ON 才生效。

进入电源模式之后，电流量程参数设置方法如下：

1、按“ $\longleftrightarrow$ ”键或旋转“旋钮”移动光标至参数选项，按下“旋钮”选中，进入参数选择界面，旋转“旋钮”或按“ $\longleftrightarrow$ ”键在下拉菜单中选择目标参数，再按下“旋钮”即可选中该参数。

■ 恒压值

设备输出电压值范围为 0-额定电压。

■ 输出限流

限流值设置范围为 0-额定电流，实际输出电流最大不会超过此设定值。

恒压值与输出限流参数操作方法相同，可使用以下两种方法设定参数：

1、按“ $\longleftrightarrow$ ”键或旋转“旋钮”移动光标至参数选项，按下“旋钮”选中，进入参数设定界面，使用数字键输入数值后按下“旋钮”确定；

2、按“ $\longleftrightarrow$ ”键或旋转“旋钮”移动光标至参数选项，按下“旋钮”选中，进入参数设定界面，然后按“ $\longleftrightarrow$ ”键移动数位光标，旋转“旋钮”调节对应数位大小，按下“旋钮”确定。

5.2.2 操作步骤示例

1、在屏幕参数配置区域，选择“通道选择”设定为“CH1”。

2、选择“恒压值”设定为“5V”，按“Enter”确认。

3、选择“电流量程”设定为“Auto”，按“Enter”确认。

4、选择“输出限流”设定为“2000mA”，按“Enter”确认。

5、接入一个 50 Ω 电阻，按“ON/OFF”键打开输出。显示屏通道状态标识为“CH1: ON: Power Mode”。

6、观察显示屏上读数，如图 5-4 所示。



图 5-4

7、完成测试，按“ON/OFF”键关闭输出。显示屏通道状态标识为“CH1: OFF”。

5.2.3 远程操作控制指令示例

表 5-2 为电池模拟器电源模式 SCPI 指令编程示例。

表 5-2

电源模式指令	描述
OUTPut1:ONOFF 0	//关闭当前通道输出
OUTPut1:MODE 0	//设定工作模式为电源模式
SOURce1:VOLTage 5.0	//设置恒压值为 5.0V
SOURce1:OUTCURRent 1000	//设置输出限流为 1000mA
SOURce1:RANGe 3	//选择电流量程 3 自动量程
OUTPut1:ONOFF 1	//开启通道 1 输出

5.3 充电模式

充电模式，可以模拟电池放电操作，用户按“Menu”键进入“充电模式”界面，界面显示如图 5-5 所示。



图 5-5 充电模式

5.3.1 参数设定

■ 通道选择

通道选择方法请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 输出限流

限流值设置范围为 0-额定电流，实际输出电流最大不会超过此设定值。

参数设置方法请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 恒压值

设定输出电压值范围为 0-额定电压。

■ 模拟内阻

模拟电池内阻设置范围为 0mΩ-100.0mΩ。

恒压值、模拟内阻参数操作方法相同，详细步骤请参考[章节 5.2.1](#)。

5.3.2 操作步骤示例

- 1、在屏幕参数配置区域，选择“通道选择”设定为“CH1”。
- 2、选择“恒压值”设定为“3.6V”，按“Enter”确认。

- 3、选择“输出限流”设定为“1000mA”，按“Enter”确认。
- 4、选择“模拟内阻”设定为“0mΩ”，按“Enter”确认。
- 5、接入一个电池（3.6V）测试，按“ON/OFF”键打开输出。显示屏通道状态标识为“CH1: ON: Change Mode”。
- 6、观察显示屏上读数，如图 5-6 所示。

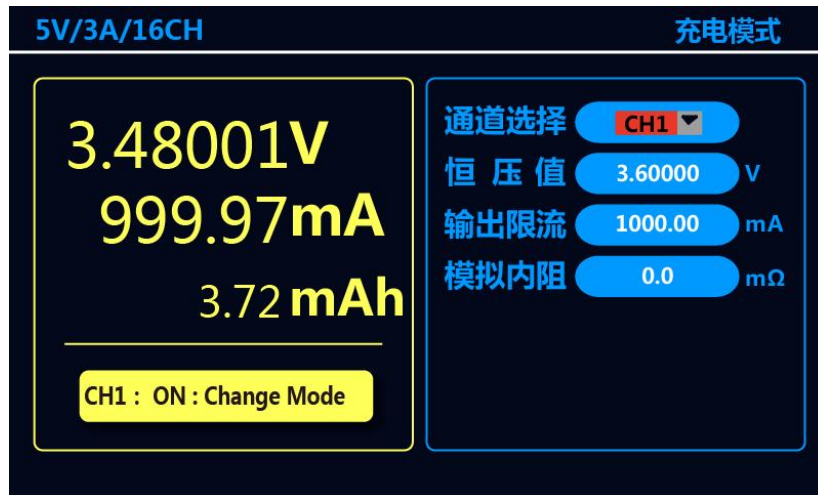


图 5-6

- 7、完成测试，按“ON/OFF”键关闭输出。显示屏通道状态标识为“CH1: OFF”。

5.3.3 远程操作控制指令示例

表 5-3 为电池模拟器充电模式 SCPI 指令编程示例。

表 5-3

充电模式指令	描述
OUTPut1:ONOFF 0	//关闭当前通道输出
OUTPut1:MODE 1	//设定工作模式为充电模式
CHARge1:VOLTage 5.0	//设置恒压值为 5.0V
CHARge1:OUTCURRent 1000	//设置输出限流为 1000mA
CHARge1:Res 3.0	//设置模拟内阻为 3.0mΩ
OUTPut1:ONOFF 1	//开启通道 1 输出

5.4 SOC 编辑

SOC 功能为模拟电池充放电功能。电池充放电过程中，电池容量越大，对应电池开路电压越高，电池内阻越低；反之，当容量下降，电池开路电压随之下降，内阻随之上升。

用户可编辑多个步骤组成的测试程序。SOC 编辑最多可配置 600 个步骤，用户可编辑每个单步的容量、恒压值、输出限流和模拟内阻。编辑完成后，进入 SOC 测试界面执行编辑的测试工步。

用户按“Shift”+“Battery”组合键进入“SOC 编辑”界面，或者在“Menu”菜单下选择“SOC 编辑”进入界面，界面显示如图 5-7 所示。

5V/3A/16CH

SOC编辑

通道选择

CH1

总步数

3

步编号

3

容量

5.00

mAh

恒压值

3.00000

V

输出限流

500.00

mA

模拟内阻

0.1

mΩ

Step No.	Q (mAh)	Voltage(V)	Out/I-Limit(mA)	Res(mΩ)
1	15.00	1.00000	500.00	0.1
2	10.00	2.00000	500.00	0.1
3	5.00	3.00000	500.00	0.1

您可通过先按“Shift”松开后再按“←”或“→”切换页面查看其他Step配置参数。

图 5-7 SOC 编辑

5.4.1 参数设定

■ 通道选择

通道选择方法请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 总步数

设备运行时所需执行的工步总数，设置范围为 0-600。

■ 步编号

工步编号，设置步编号后，再设置编号对应工步参数，设置范围为 1-600。

■ 容量

即工步对应的步容量。

■ 恒压值

恒压值设置范围为 0-额定电压。

■ 模拟内阻

模拟电池内阻设置范围为 0mΩ-100.0mΩ。

总步数、步编号、容量、恒压值、模拟内阻参数设定方法相同，详细步骤请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 输出限流

限流值设置范围为 0-额定电流，实际输出电流最大不会超过此设定值。参数设置方法请参考[章节 5.2.1](#)。

5.4.2 操作步骤示例

- 1、在屏幕参数配置区域，选择“通道选择”设定为“CH1”。
- 2、选择“总步数”设定为“3”，按“Enter”确认。

步编号 1-3 的参数：

表 5-4

步编号	容量(mAh)	恒压值 (V)	输出限流 (mA)	模拟内阻 (mΩ)
1	100	3.0000	1000.0	0.1
2	90	2.0000	1000.0	0.2
3	80	1.0000	1000.0	0.3

参数设置完成后，如图 5-8 所示：

5V/3A/16CH

SOC编辑

通道选择 CH1

总步数 3

步编号 3

容量 80.00 mAh

恒压值 1.00000 V

输出限流 1000.00 mA

模拟内阻 0.3 mΩ

Step No.	Q (mAh)	Voltage(V)	Out/I-Limit(mA)	Res(mΩ)
1	100.00	3.00000	1000.00	0.1
2	90.00	2.00000	1000.00	0.2
3	80.00	1.00000	1000.00	0.3

您可通过先按“Shift”松开后再按“+”或“-”切换页面查看其他Step配置参数.

图 5-8

5.5 SOC 测试

SOC 工步编辑完成后，进入 SOC 测试界面，选择通道，设置初始电压，按 On/Off 启动。

用户按“Battery”键进入“SOC 测试”界面，或在“Menu”菜单下选择“SOC 测试”进入界面，界面显示如图 5-9 所示：



图 5-9 SOC 测试

5.5.1 参数设定

■ 通道选择

通道选择方法请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 初始电压

初始电压是指模拟电池初始电压设定之后，设备将以此电压开始充/放电。

进入 SOC 测试界面，参数设置方法请参考[章节 5.2.1](#)。



注意

初始电压应小于工步中的最大电压，大于工步中最小电压。

5.5.2 操作步骤示例

- 1、在屏幕参数配置区域，选择“通道选择”设定为“CH1”。
- 2、选择“初始电压”设定为“2.8V”，按“Enter”确认。
- 3、输出接一个电阻（ 2Ω ），按“ON/OFF”键打开输出。显示屏通道状态标识为“CH1: ON: SOC Mode”。
- 4、观察显示屏上读数，如图 5-10 所示。



图 5-10

- 5、完成测试，按“ON/OFF”键关闭输出。显示屏通道状态标识为“CH1: OFF”。

5.5.3 远程操作控制指令示例

表 5-5 为电池模拟器 SOC 功能 SCPI 指令编程示例。

表 5-5

SOC 测试指令	描述
OUTPut1:ONOFF 0	//关闭当前通道输出
OUTPut1:MODE 3	//设定工作模式为 SOC 模式
SOC1:EDIT:LENGth 3	//设置 SOC 总步数为 3
SOC1:EDIT:STEP 1	//设置步编号为 1
SOC1:EDIT:Q 1000	//设置编辑步 1 容量值为 1000mAh
SOC1:EDIT:VOLTage 5.0	//设置编辑步 1 恒压值为 5.0V
SOC1:EDIT:OUTCURREnt 1000	//设置编辑步 1 输出限流为 1000mA
SOC1:EDIT:Res 0.1	//设置编辑步 1 模拟内阻为 0.1mΩ
SOC1:EDIT:STEP 2	//设置步编号为 2
SOC1:EDIT:Q 900	//设置编辑步 2 容量值为 900mAh
SOC1:EDIT:VOLTage 4.0	//设置编辑步 2 恒压值为 4.0V
SOC1:EDIT:OUTCURREnt 1000	//设置编辑步 2 输出限流为 1000mA
SOC1:EDIT:Res 0.2	//设置编辑步 2 模拟内阻为 0.2mΩ
SOC1:EDIT:STEP 3	//设置步编号为 3
SOC1:EDIT:Q 800	//设置编辑步 3 容量值为 800mAh
SOC1:EDIT:VOLTage 3.0	//设置编辑步 3 恒压值为 3.0 V
SOC1:EDIT:OUTCURREnt 1000	//设置编辑步 3 输出限流为 1000 mA
SOC1:EDIT:Res 0.3	//设置编辑步 3 模拟内阻为 0.3 mΩ
SOC1:EDIT:SVOL 4.8	//设定 SOC 初始电压为 4.8V
OUTPut1:ONOFF 1	//开启通道 1 输出
SOC1:RUN:STEP?	//读取 SOC 模式当前运行步编号
SOC1:RUN:Q?	//读取 SOC 模式当前运行步累计容量

5.6 序列编辑

用户可编辑由多个步骤组成的测试序列。序列功能最多可编辑 10 个序列文件（文件 1-文件 10），1 个序列文件最多可配置 600 个步骤，用户可编辑每个单步恒压值、输出限流、模拟内阻以及运行时间。步与步之间也可以嵌套，独立设置相应的循环模式。

进行序列测试时，设备根据当前选择的运行文件判断步大小，根据设置的每步输出参数进行顺序执行。

用户按“Shift”+“SEQ”组合键进入“序列编辑”界面，或在“Menu”菜单下选择“序列编辑”进入界面，界面显示如图 5-11 所示：

5V/3A/16CH
序列编辑

通道选择 CH1

文件编号 1

总步数 3

文件运行次数 1

步编号 3

恒压值 3.00000 V

输出限流值 3000.00 mA

模拟内阻 0.1 mΩ

运行时间 6.000 S

链接开始编号 -1

链接结束编号 -1

链接运行次数 0

Step No.	Voltage(V)	OUT/I-Limit(mA)	Res(mΩ)	Dwell(S)
1	1.00000	1000.00	0.1	3.000
2	2.00000	2000.00	0.1	6.000
3	3.00000	3000.00	0.1	6.000

您可通过先按“Shift”松开后再按“←”或“→”切换页面查看其他Step配置参数。

图 5-11 序列编辑

5.6.1 参数设定

■ 通道选择

通道选择方法请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 文件编号

序列文件对应的编号，设置范围为 1-10。

■ 总步数

当前序列文件需要执行的工步总数，设置范围为 0-600。

■ 文件运行次数

序列文件运行次数，设置范围为 0-100。

■ 步编号

工步编号，设置步编号后，再设置编号对应工步的参数，步编号设置范围为 1-600。

■ 恒压值

设定输出电压值设置范围为 0-额定电压。

■ 输出限流

限流值设置范围为 0-额定电流，实际输出电流最大不会超过此设定值。参数设置方法请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 模拟内阻

模拟电池内阻设置范围为 0mΩ-100.0mΩ。

■ 运行时间

工步运行时间。设置范围为 0-100.000s

■ 链接开始编号

链接开始步编号，设置范围为-1-600，-1 代表无效，0 和工步对应数字代表运行当前工步。

■ 链接结束编号

链接结束步编号，设置范围为-1-600，-1 代表无效，0 和工步对应数字代表运行当前工步。

例如：若当前编辑步编号为 3，链接开始/结束编号设定为 0 或者 3 则都代表运行工步 3。

■ 链接运行次数

链接开始编号至链接结束编号的运行次数。

例如：步编号为 3 的工步参数中，设定链接开始编号为 1，结束编号为 2，链接运行次数为 2，则代表当工步 3 设定的运行时间结束后，设备会从工步 1 开始运行，再运行工步 2，循环运行 2 次后链接结束。

文件编号、总步数、文件运行次数、步编号、恒压值、模拟内阻、运行时间、链接开始编号、链接结束编号、链接运行次数参数设定方法相同，详细步骤请参考[章节 5.2.1](#)。

5.6.2 操作步骤示例

- 1、在屏幕参数配置区域，选择“通道选择”设定为“CH1”。
- 2、选择“文件编号”设定为“1”，按“Enter”确认。
- 3、选择“总步数”设定为“3”，按“Enter”确认。
- 4、选择“文件运行次数”设定为“1”，按“Enter”确认。

步编号 1-3 的参数：

表 5-6

步编号	恒压值 (V)	输出限流 (mA)	模拟内阻 (mΩ)	运行时间 (s)
1	2.0000	1000.0	0.0	5.000
2	3.0000	1000.0	0.1	10.000
3	3.5000	1000.0	0.2	20.000

参数设置完成后，如图 5-12 所示：



图 5-12

5.7 序列测试

序列测试主要根据当前选择的运行文件判断步大小，根据设置每步输出参数进行顺序执行。用户按“SEQ”键进入“序列测试”界面，或在“Menu”菜单下选择“序列测试”进入界面，界面显示如图 5-13 所示：



图 5-13 序列测试

5.7.1 参数设定

■ 通道选择

通道选择方法请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 文件编辑

选择当前运行文件编号，参数设置方法请参考[章节 5.2.1](#)。

5.7.2 操作步骤示例

- 1、在屏幕参数配置区域，选择“通道选择”设定为“CH1”。
- 2、选择“文件编号”设定为“1”，按“Enter”确认。



注意

该操作是在序列编辑完成后。

- 3、输出接一个电阻（ 3.3Ω ），按“ON/OFF”键打开输出。显示屏通道状态标识为“CH1: ON: SEQ Mode”。
- 4、观察显示屏上读数，如图 5-14 所示。



图 5-14

- 5、完成测试，按“ON/OFF”键关闭输出。显示屏通道状态标识为“CH1: OFF”。

5.7.3 远程操作控制指令示例

表 5-7 为电池模拟器序列测试功能 SCPI 指令编程示例。

表 5-7

序列测试指令	描述
OUTPut1:ONOFF 0	//关闭当前通道输出
OUTPut1:MODE 128	//设定工作模式为 SEQ 序列模式
SEQuence1:EDIT:FILE 1	//设置序列当前编辑文件为 1
SEQuence1:EDIT:LENGth 3	//设置总步数为 3
SEQuence1:EDIT:Cycle 1	//设置序列文件运行次数为 1
SEQuence1:EDIT:STEP 1	//设置当前步编号为 1
SEQuence1:EDIT:VOLTage 1.0	//设置当前编辑步 1 恒压值为 1.0V
SEQuence1:EDIT:OUTCURRent 1000	//设置当前编辑步 1 输出限流为 1000mA
SEQuence1:EDIT:Res 0.0	//设置当前编辑步 1 模拟内阻为 0mΩ
SEQuence1:EDIT:RUNTime 5	//设置当前编辑步 1 运行时间为 5s
SEQuence1:EDIT:LINKStart -1	//设置当前编辑步 1 链接开始编号为-1
SEQuence1:EDIT:LINKEnd -1	//设置当前编辑步 1 链接结束编号为-1
SEQuence1:EDIT:LINKCycle 0	//设置当前编辑步 1 链接运行次数为 0
SEQuence1:EDIT:STEP 2	//设置当前步编号为 2
SEQuence1:EDIT:VOLTage 2.0	//设置当前编辑步 2 恒压值为 2.0V
SEQuence1:EDIT:OUTCURRent 1000	//设置当前编辑步 2 输出限流为 1000mA
SEQuence1:EDIT:Res 0.1	//设置当前编辑步 2 模拟内阻为 0.1mΩ
SEQuence1:EDIT:RUNTime 10	//设置当前编辑步 2 运行时间为 10s
SEQuence1:EDIT:LINKStart -1	//设置当前编辑步 2 链接开始编号为-1
SEQuence1:EDIT:LINKEnd -1	//设置当前编辑步 2 链接结束编号为-1
SEQuence1:EDIT:LINKCycle 0	//设置当前编辑步 2 链接运行次数为 0
SEQuence1:EDIT:STEP 3	//设置当前步编号为 3
SEQuence1:EDIT:VOLTage 3.0	//设置当前编辑步 3 恒压值为 3.0V
SEQuence1:EDIT:OUTCURRent 1000	//设置当前编辑步 3 输出限流为 1000mA
SEQuence1:EDIT:Res 0.2	//设置当前编辑步 3 模拟内阻为 0.2mΩ
SEQuence1:EDIT:RUNTime 20	//设置当前编辑步 3 运行时间为 20s
SEQuence1:EDIT:LINKStart -1	//设置当前编辑步 3 链接开始编号为-1
SEQuence1:EDIT:LINKEnd -1	//设置当前编辑步 3 链接结束编号为-1
SEQuence1:EDIT:LINKCycle 0	//设置当前编辑步 3 链接运行次数为 0
SEQuence1:RUN:FILE 1	//设置当前序列运行文件为 1
OUTPut1:ONOFF 1	//开启通道 1 输出
SEQuence1:RUN:STEP?	//读取序列模式下当前运行步编号
SEQuence1:RUN:Time?	//读取当前序列运行时间

5.8 实时曲线

用户按“Graph”键进入“实时曲线”界面，或者在“Menu”菜单下选择“实时曲线”进入界面，界面显示如图 5-15 所示：

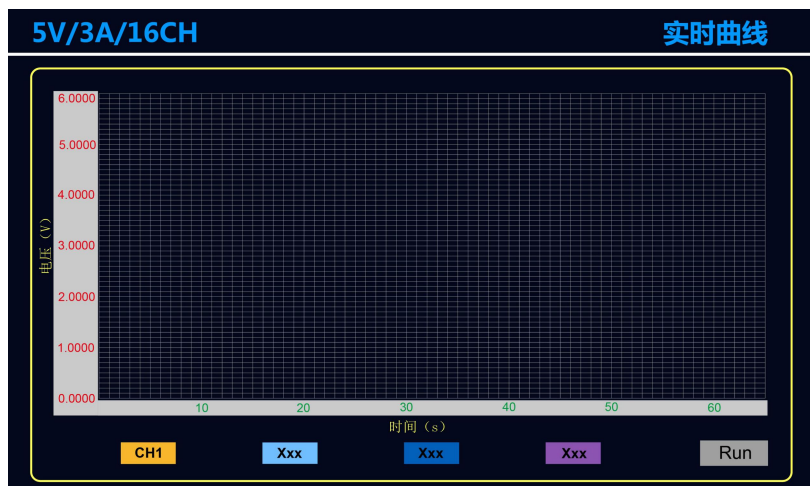


图 5-15 实时曲线

可同时显示任意四个通道电压值实时曲线图。

操作方法：按“←→”键或旋转“旋钮”移动光标至通道显示栏，按下“旋钮”选中，然后旋转“旋钮”切换通道，按下“旋钮”确定。

通道设置完成，移动光标至“Run”按钮处，按下“旋钮”即可启动。

5.9 通道回读

用户按“ALL CH”键进入“通道回读”界面，或在“Menu”菜单下选择“通道回读”进入界面，界面显示如图 5-16 所示：

5V/3A/16CH				回读模式
Chn	Voltage(V)	Current(mA)	Power(W)	State
1	0.00000	0.00	0.000	OFF
2	0.00000	0.00	0.000	OFF
3	0.00000	0.00	0.000	OFF
4	0.00000	0.00	0.000	OFF
5	0.00000	0.00	0.000	OFF
6	0.00000	0.00	0.000	OFF
7	0.00000	0.00	0.000	OFF
8	0.00000	0.00	0.000	OFF

电压(Voltage)单位：V 电流(Current)单位：mA 功率(Power)单位：W

上一页
下一页
自动翻页

图 5-16 通道回读

在“通道回读”界面，可查看各个通道的电压值、电流值、功率值及 On/Off 状态。

5.10 系统配置

用户按“Shift”+“Menu”组合键进入“系统配置”界面，或者在“Menu”菜单下选择“系统配置”进入“系统配置”界面，界面显示如图 5-17 所示：

图 5-17 系统配置

5.10.1 通讯设置

■ 网络 IP

IP 地址默认为 192.168.0.123，可更改设置，更改完成后重启生效。

设定方法：按“←→”键或旋转“旋钮”移动光标至“网络 IP”选项，按下“旋钮”选中，进入到参数设定界面，使用数字键输入数值后按下“旋钮”确定。

■ 波特率

N8336 支持多种波特率，可以根据需要进行更改（可选择 9600、19200、38400、57600、115200），更改完成后重启生效。

■ 蜂鸣器

此选项可以设置设备按键声音 ON/OFF。

■ 语言

N8336 支持中文和英文显示。

■ 设备地址

设置设备地址。当设备地址为 1 时，此台设备通道地址依次为 1-16；当设备地址为 2 时，此台设备通道地址依次为 25-40。

波特率、蜂鸣器、语言、设备地址参数设定方法相同，详细步骤请参考[章节 5.2.1](#)。

5.10.2 其它参数

■ 通道选择

通道选择方法请参考[章节 5.2.1](#)。

■ 设定值

设定采样速度。可选择 Fast（10ms）、Medi（120ms）、Slow（480ms），默认采集速度为 Medi。参数设置方法请参考[章节 5.2.1](#)。

5.11 CAN 设置

用户可以通过在“Menu”菜单下选择“CAN 设置”进入“CAN 设置”界面，界面显示如图 5-18 所示：

5V/3A/16CH

CAN设置

起点 ID地址

1

CAN 波特率

250

k

主动上传时间

100

ms

Channel	CAN ID	Rate(K)	time(ms)	Channel	CAN ID	Rate(K)	time(ms)
1	1	250	100	13	13	250	100
2	2	250	100	14	14	250	100
3	3	250	100	15	15	250	100
4	4	250	100	16	16	250	100
5	5	250	100				
6	6	250	100				
7	7	250	100				
8	8	250	100				
9	9	250	100				
10	10	250	100				
11	11	250	100				
12	12	250	100				

图 5-18 CAN 设置

■ CAN ID 地址

设定设备 CAN ID 地址（默认为 1），当“CAN ID 地址”为 1 时，16 通道的 CAN ID 依次为 1-16，当“CAN ID 地址”为 2 时，16 通道的 CAN ID 依次为 25-40，以此类推。

■ CAN 波特率

N8336 支持多种 CAN 波特率，更改波特率后，重启生效。

■ 主动上传时间

设备在每次间隔时间上传一次数据。

CAN 波特率、主动上传时间参数设定方法相同，详细步骤请参考[章节 5.2.1](#)。

5.12 恢复出厂

用户按“Menu”键进入菜单，选择“恢复出厂”进入界面，按“Enter”键即可恢复出厂设置，界面显示如图 5-20 所示。



图 5-20 恢复出厂

5.13 关于我们

用户按“Menu”键进入菜单，选择“关于我们”进入界面，界面显示如图 5-21 所示。在此界面按下“Shift”键会显示此台设备的出厂 SN 号和软件版本信息。



图 5-21 关于我们

六、维护与校准

6.1 保修服务

NGI 保证本仪器规格和使用特性完全达到手册中所声称的各项技术指标, 并对本仪器所采用的原材料和制造工艺均严格把控, 确保仪器稳定可靠。

自购买日起一年内, 仪器在正常使用与维护状态下所发生的一切故障, NGI 负责免费维修。对于免费维修的产品, 用户需预付寄送单程运费, 回程运费由 NGI 承担。若仪器从其它国家返厂维修, 则所有运费、关税及其它税费均需由用户承担。

6.2 保修限制

保修服务仅限于仪器主机(保险管、测试线等易损件除外)。对于因错误使用、无人管理、未经授权的修改、非正常环境下使用以及不可抗拒因素所造成的损坏, 不在保修服务范围内, 如需维修我司将在维修前提供估价单。

仅作以上保证, 不作其它明示或默示性保证, 其中包括适销性、某些特定应用的合理性与适用性等的默示保证。无论在合同中、民事过失上, 或是其它方面, NGI 不对任何特殊的、偶然或间接的损害负责。

6.3 日常维护

清洁设备

要清洁仪器, 请使用蘸有去离子水或温和水性清洁剂的无尘布, 清洁仪器外部。请不要将清洁剂直接用于仪器, 或使液体进入仪器内或溅到仪器上。如果仪器内部被污染, 操作将受到影响, 建议将仪器返回工厂进行清洁/维修。



建议每年定期清洁一次, 在清洁之前, 请断开电源!

6.4 故障排查

设备故障排查

若仪器使用过程中发生故障，请先进行简单排查。若通过简单排查操作能解决仪器故障，则能节省维修成本和时间。

故障排查案例：

1、空载电压无输出

- (1) 检查预设电压值是否为 0V；
- (2) 电流值预设值是否 $\geq 0.1\text{A}$ 。

2、带载电压无输出或输出值低

- (1) 检查负载是否短路；

3、显示信息异常

(1) 按输出就显示过压报警，请进入保护设置菜单查看 OVP 设置值是否低于电压预设值，将 OVP 设置值调高于电压预设值，退出菜单后再输出。(限于有保护设置功能的产品)

(2) 开机显示屏不亮，检查电源连接是否正常，保险丝是否烧断。

若排查未能解决相关问题，则请联系恩智（NGI）授权经销商或售后服务部门。联系前请做好一下准备：

1、请仔细阅读手册声明中的“[保修服务](#)”及“[保修限制](#)”内容。确认仪器是否符合保修服务条件。

2、如仪器需寄回厂家进行维修，请参见“[返厂维修](#)”中的说明。

3、请提供相关 SN 编号（SN 编号将是得到有效的服务和完整信息的有效保证）。获取编号方式：查看仪器标签上的序列号。

校准间隔

恩智（NGI）建议 N8336 系列产品校准频率为 1 次/年。

6.5 返厂维修

通过有效沟通后，如双方达成返厂维修协议，请仔细阅读以下内容：

包装仪器

仪器在返厂前，请参照以下步骤包装你所需要寄出的仪器：

- 1、请将需要维修的仪器装入发货时使用的包装箱，并附带相关附件。
- 2、提供详细问题描述，如相关错误信息拷贝文件或关于问题的描述信息。
- 3、运送时请注意阅读“[保修服务](#)”中运送费用的相关说明。

注意

- 1、仪器运送过程中如果使用非指定包装时有可能导致仪器损坏，所以请使用发货时的专用包装箱，并尽量按照发货时的包装标准进行包装。
 - 2、请勿使用任何形状的苯乙烯微粒作为包装材料。它们不能很好固定仪器，也不能防止仪器在包装箱内晃动，而且苯乙烯微粒产生静电会损坏仪器。
-

七、主要技术指标



测量精度是在校准后一年内，温度在 18℃~28℃，相对湿度达 80% 时来认定的。另外，精度测量前，请预热半小时。

表 7-1

型号	N8336-06-01		N8336-05-03	
电流	1A/CH		3A/CH	
电压	6V/CH		5V/CH	
功率	6W/CH		15W/CH	
通道数	16CH			
	恒电流模式			
量程	0~1A	0~1mA	0~3A	0~1mA
设定分辨率	0.01mA	0.01μA	0.01mA	0.01μA
设定精度(23±5℃)	0.001%+0.5mA	0.001%+0.5μA	0.001%+1.5mA	0.001%+0.5μA
回读分辨率	0.01mA	0.01μA	0.01mA	0.01μA
回读精度(23±5℃)	0.001%+0.5mA	0.001%+0.5μA	0.001%+1.5mA	0.001%+0.5μA
温度系数(0~40℃)	20ppm/℃			
长时间稳定性	40ppm/1000h			
	恒电压模式			
量程	0-6V		0-5V	
设定分辨率	0.01mV			
设定精度(23±5℃)	0.001%+0.1mV			
回读分辨率	0.01mV			
回读精度(23±5℃)	0.001%+0.1mV			
温度系数(0~40℃)	10ppm/℃			
长时间稳定性	40ppm/1000h			
电压纹波噪声 (20Hz~20MHz)	≤2mVrms			
	动态特性			
电压上升时间 (10%~90%的变化时间)	≤25ms（空载）			
电压上升时间 (10%~90%的变化时间)	≤25ms（满载）			
电压下降时间 (90%~10%的变化时间)	≤3s（空载）			
电压下降时间 (90%~10%的变化时间)	≤10ms（满载）			

瞬态恢复时间 ¹	≤100μs
	其他
耐压(输出对大地)	1000V DC
耐压(通道与通道)	500V DC
通讯响应时间	≤10ms
通讯接口	LAN/RS485(隔离)/CAN
输入	电压220VAC±10%，电流<2A，频率47Hz~63Hz
温度规格	工作温度：0℃~40℃；存储温度：-20℃~60℃
工作环境	海拔<2000m；相对湿度：5%~90%(无结露)；适用气压：80~110Kpa
尺寸	88mm(H)*482mm(W)含把手*557mm(D)
净重	约20kg

注 1：在满电压输出下，负载由 10%突变到 90%，电压恢复到（原电压减 50mV）以内。

备注：此产品手册仅供参考，如需其他规格，请咨询 NGI 官网/官微以获取最新产品信息。公司产品会不断更新，技术指标变更时不另行通知，谢谢合作。



电 子 电 路 与 测 控 技 术 方 案 提 供 商

恩智（上海）测控技术有限公司

服务热线：400-966-2339

官方邮箱：sales@ngitech.cn

恩智网站：Http://www.ngitech.cn



公众号二维码



官网二维码

上海分公司 长沙分公司 苏州分公司 成都分公司 山东分公司 武汉分公司 深圳分公司

备注:产品信息如有变更恕不另行通知，最终解释权归恩智测控所有，更多详细内容，可登录网站了解或联系销售、技术工程师咨询。